


# 100年度 CHT 確診醫院第三次 T<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-06      檢體寄出日期：100年6月27日      報告截止日期：100年7月4日  
 回收份數(比率)：23份(100%)


## Sample S1



## 檢體 S1


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	11.6	11.5 (10)	0.64	5.5%
04	12	14.0	13.5 (12)	1.11	8.2%
All	23	12.1	12.6 (22)	1.36	10.8%

\* Outlier(s) not included.



T<sub>4</sub> [ug/dL]


## Sample S2



## 檢體 S2


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	7.9	8.1 (10)	0.54	6.8%
04	12	9.6	9.6 (12)	0.92	9.6%
All	23	8.6	8.7 (23)	1.31	15.0%

\* Outlier(s) not included.



T<sub>4</sub> [ug/dL]


## Sample S3



## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	4.4	4.3 (10)	0.30	6.9%
04	12	5.0	5.0 (12)	0.35	7.0%
All	23	4.6	4.7 (22)	0.47	10.0%

\* Outlier(s) not included.

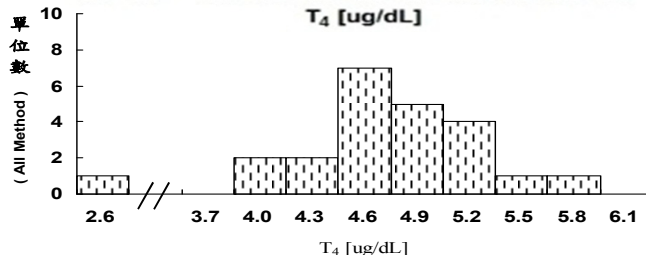

T<sub>4</sub> [ug/dL]