


100 年度 CHT 確診醫院第三次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖



送檢批號：CHT2011-06 檢體寄出日期：100 年 6 月 27 日 報告截止日期：100 年 7 月 4 日
 回收份數(比率)：23 份 (100%)

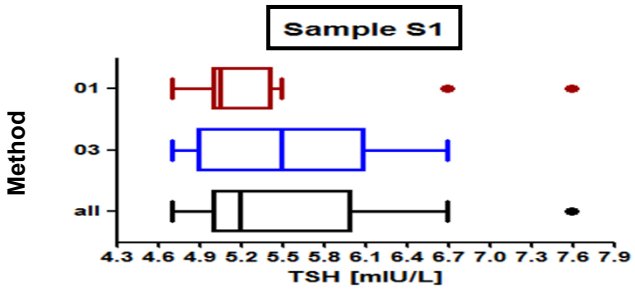

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	5.1	5.0 (10)	0.22	4.3%
03	11	5.5	5.6 (11)	0.66	11.9%
All	23	5.2	5.4 (22)	0.62	11.5%



* Outlier(s) not included.

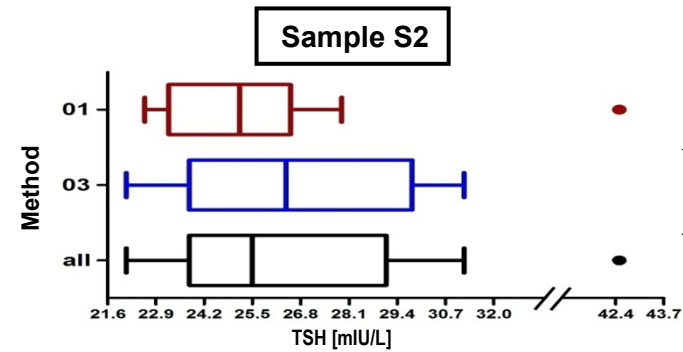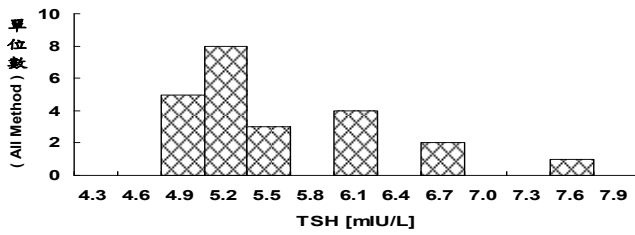

檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	25.2	24.8 (11)	1.68	6.8%
03	11	26.4	27.1 (11)	3.21	11.9%
All	23	25.5	26.0 (22)	2.77	10.7%

* Outlier(s) not included.

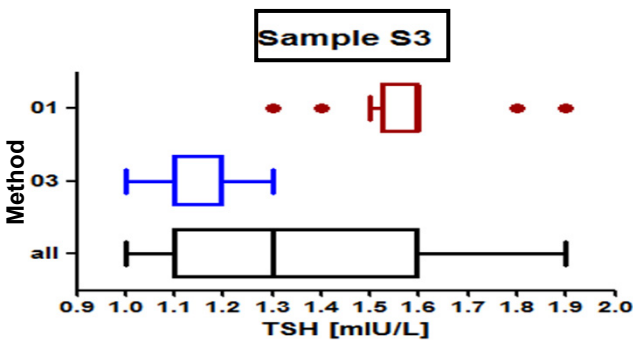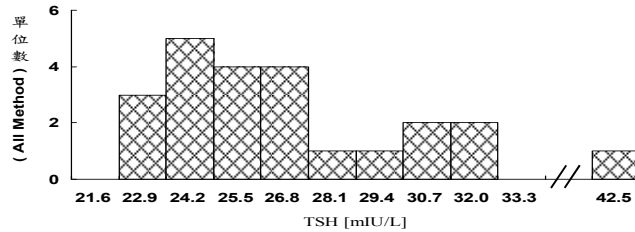

檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	1.6	1.6 (8)	0.04	2.2%
03	11	1.1	1.1 (11)	0.08	7.1%
All	23	1.3	1.4 (23)	0.26	19.2%

* Outlier(s) not included.

