


100 年度 CHT 確診醫院第四次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-09

檢體寄出日期：100 年 9 月 19 日

報告截止日期：100 年 9 月 26 日


回收份數(比率)：23 份 (100%)

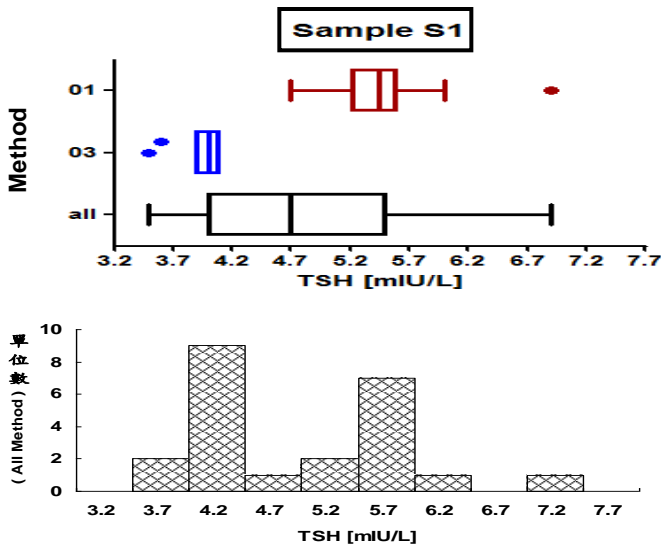

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	5.5	5.4 (11)	0.34	6.3%
03	11	4.0	4.0 (9)	0.07	1.8%
All	23	4.7	4.8 (23)	0.89	18.8%


* Outlier(s) not included.

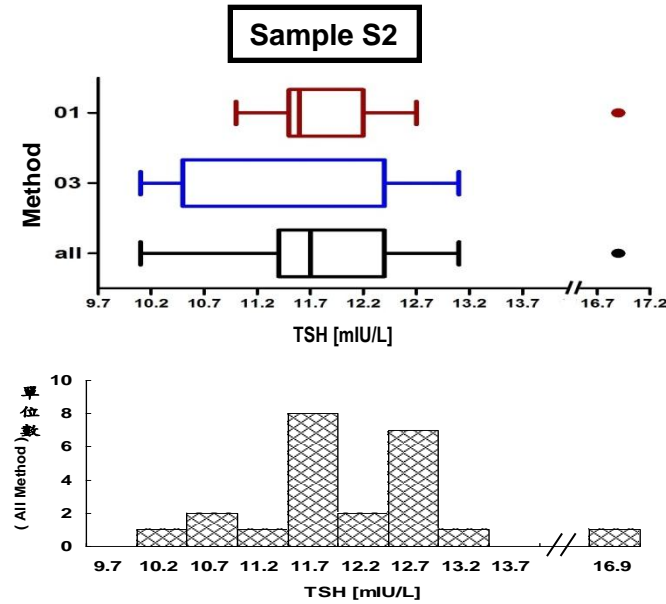

檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	11.6	11.7 (11)	0.46	3.9%
03	11	12.4	11.8 (11)	1.03	8.8%
All	23	11.7	11.7 (22)	0.78	6.6%

* Outlier(s) not included.

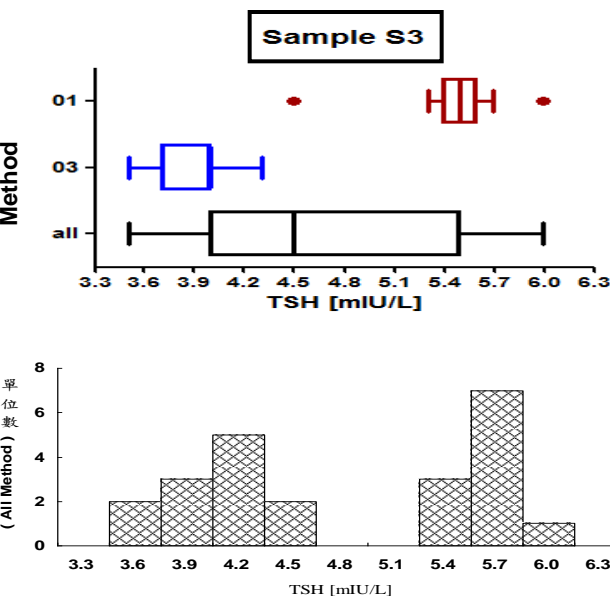

檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	5.5	5.5 (10)	0.12	2.1%
03	11	4.0	3.9 (11)	0.23	5.8%
All	23	4.5	4.7 (23)	0.85	18.1%

* Outlier(s) not included.