



100 年度 CHT 確診醫院第五次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-11

檢體寄出日期：100 年 11 月 14 日



報告截止日期：100 年 11 月 21 日

回收份數(比率)：23 份 (100%)




Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	5.0	5.0 (11)	0.26	5.3%
03	11	5.4	5.4 (11)	0.56	10.4%
All	23	5.1	5.1 (21)	0.38	7.4%

* Outlier(s) not included.

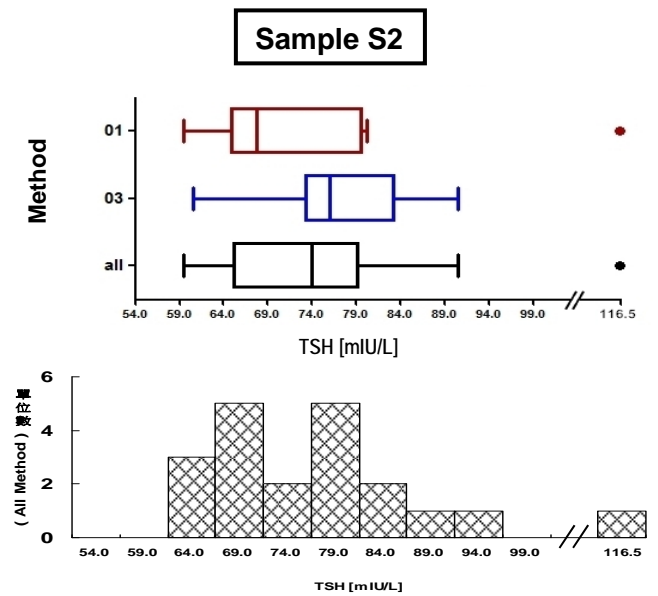

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	67.7	68.6 (10)	7.25	10.6%
03	11	76.0	77.1 (9)	8.74	11.3%
All	23	74.0	72.6 (19)	8.91	12.3%

* Outlier(s) not included.

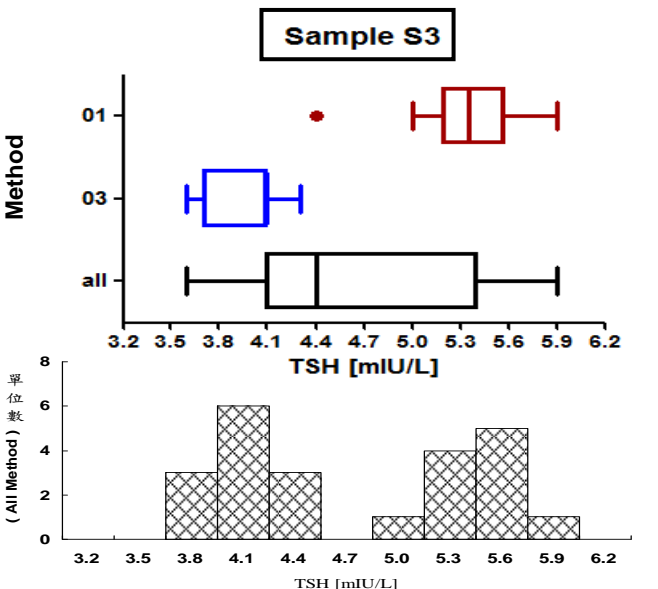

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	5.4	5.4 (11)	0.24	4.5%
03	11	4.1	4.0 (11)	0.24	6.0%
All	23	4.4	4.7 (23)	0.75	16.0%

* Outlier(s) not included.