



101 年度 CHT 確診醫院第一次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-02

檢體寄出日期：101 年 02 月 20 日

報告截止日期：101 年 02 月 27 日


回收份數(比率)：23 份 (100%)

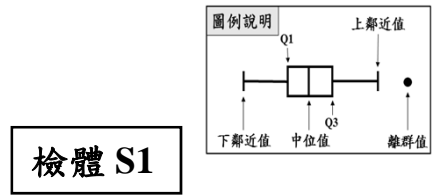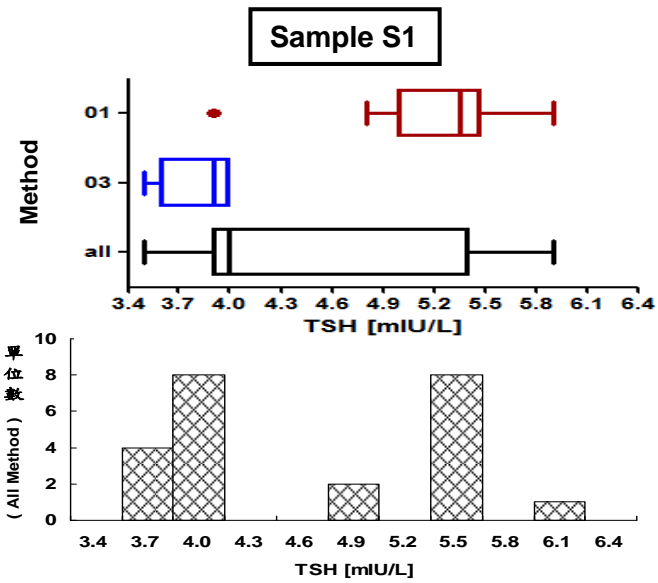

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	5.4	5.3 (11)	0.29	5.5%
03	11	3.9	3.8 (11)	0.18	4.8%
All	23	4.0	4.5 (23)	0.81	17.8%


* Outlier(s) not included.

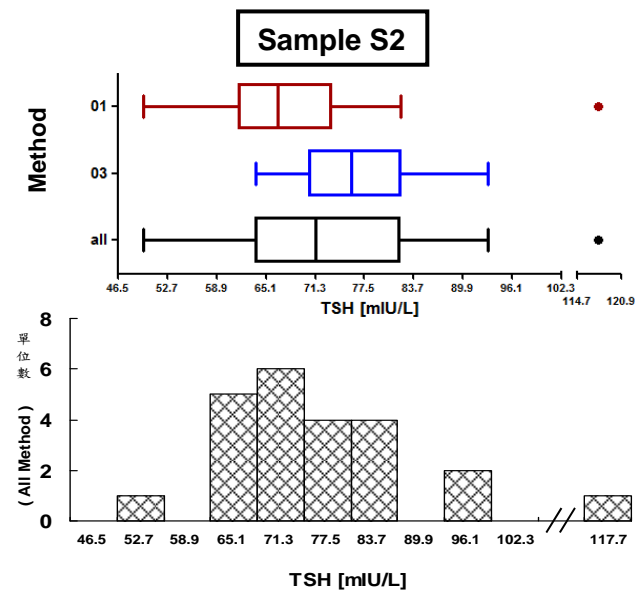

檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	66.7	66.1 (11)	8.42	12.7%
03	11	75.8	77.7 (11)	9.26	11.9%
All	23	71.3	71.9 (22)	10.48	14.6%

* Outlier(s) not included.

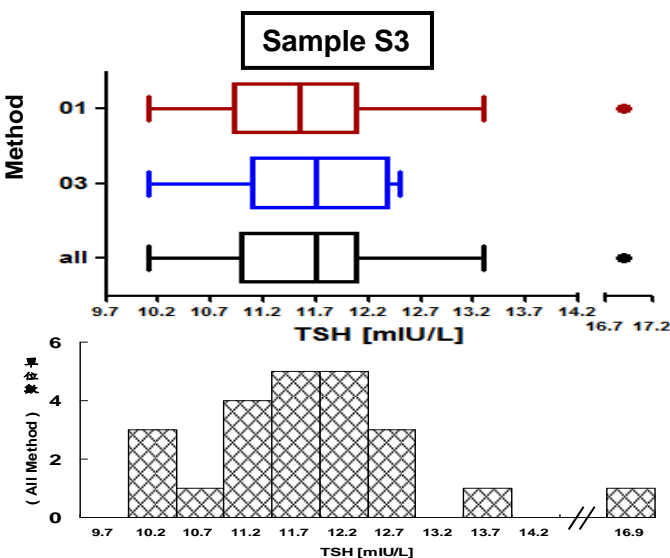

檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	11.6	11.5 (11)	0.87	7.6%
03	11	11.7	11.6 (11)	0.85	7.3%
All	23	11.7	11.5 (22)	0.84	7.3%

* Outlier(s) not included.