



# AQ2013-06 批次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：AQ2013-06      檢體寄出日期：102 年 06 月 03 日      報告截止日期：102 年 06 月 10 日  
 回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1


檢體 S1

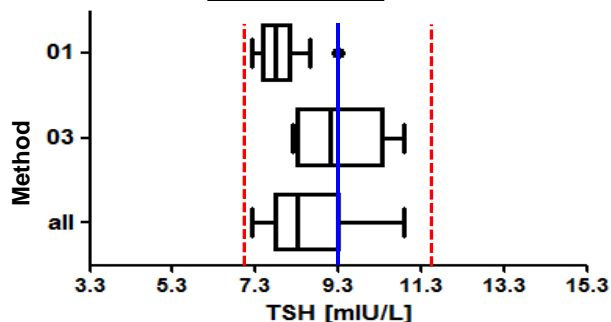

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	7.8	7.9	0.53	6.7%
03	11	9.1	9.3	1.10	11.8%
All	21	8.3	8.6	1.07	12.3%
AEL*	1411	9.3	9.3	1.31	14.1%

Sample S2


檢體 S2

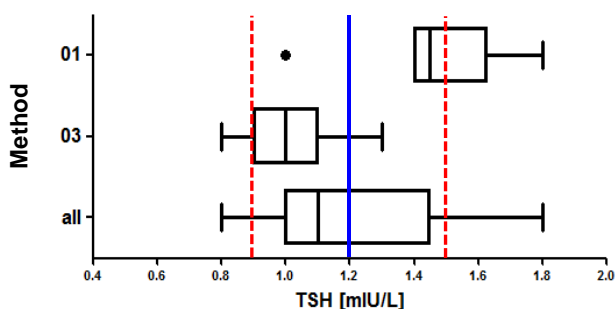


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	1.5	1.5	0.19	12.7%
03	11	1.0	1.0	0.13	13.0%
All	21	1.1	1.2	0.31	25.8%
AEL*	1377	1.2	1.2	0.17	14.4%

\* All European Laboratories

\* — Target, - - - MAD

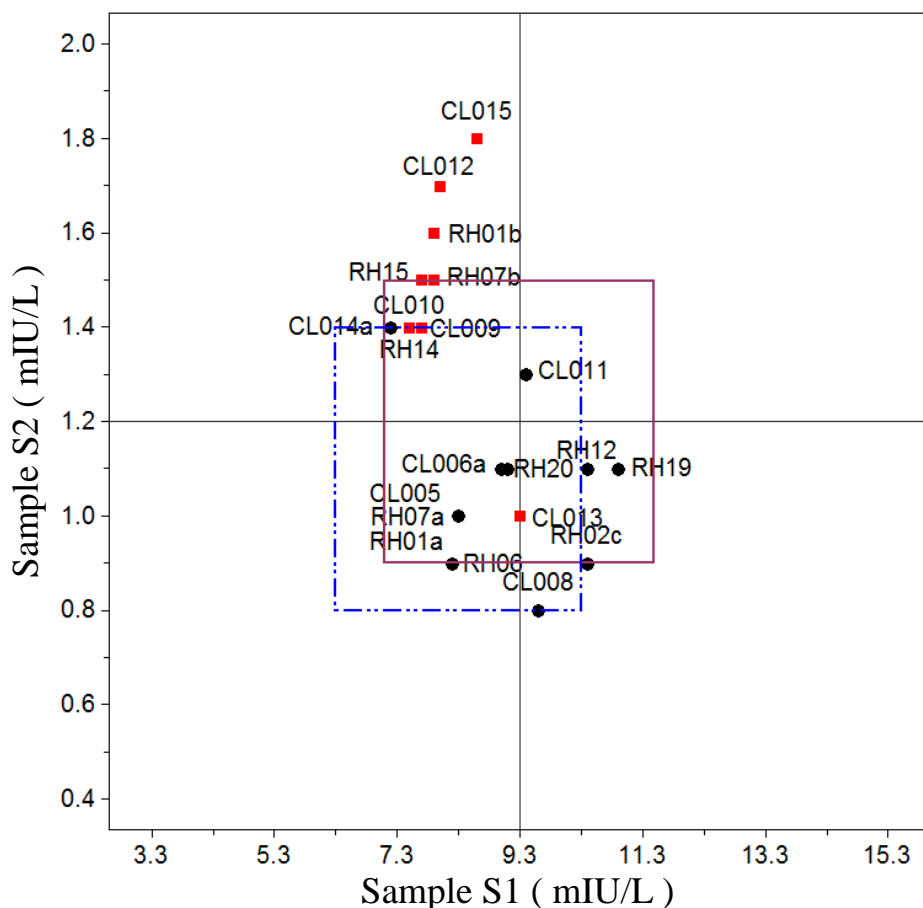

Youden Plot 圖例說明

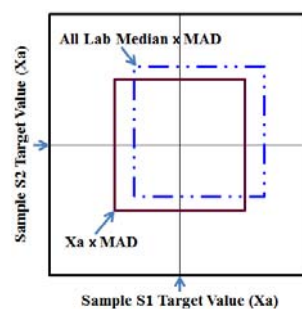

■ Method 01 (RIA)  
 ● Method 03 (CLIA)  
 Maximum allowable deviation (MAD) = 24%