


100 年度 CHT 確診醫院第一次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2011-02 檢體寄出日期：100 年 2 月 21 日 報告截止日期：100 年 3 月 1 日
 回收份數(比率)：23 份 (100%)

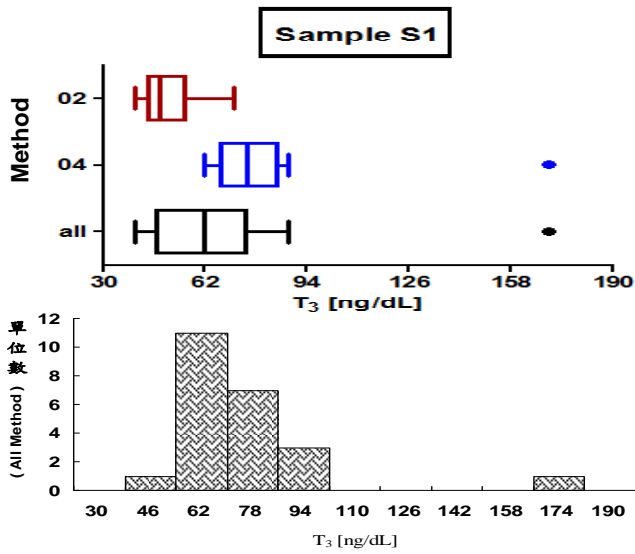

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	48	51 (12)	9.0	17.8%
04	11	75	74 (10)	8.6	11.6%
All	23	62	61 (22)	14.7	24.0%


* Outlier(s) not included.

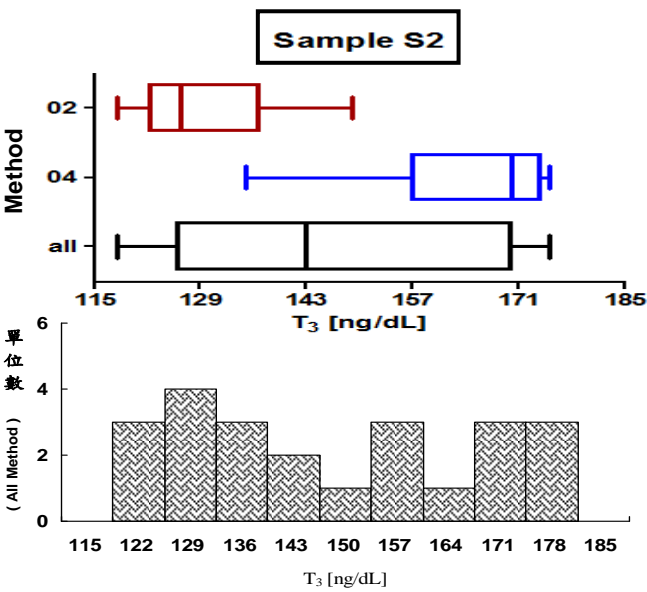

檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	127	130 (12)	9.8	7.5%
04	11	170	164 (11)	12.5	7.6%
All	23	143	146 (23)	20.3	13.9%

* Outlier(s) not included.

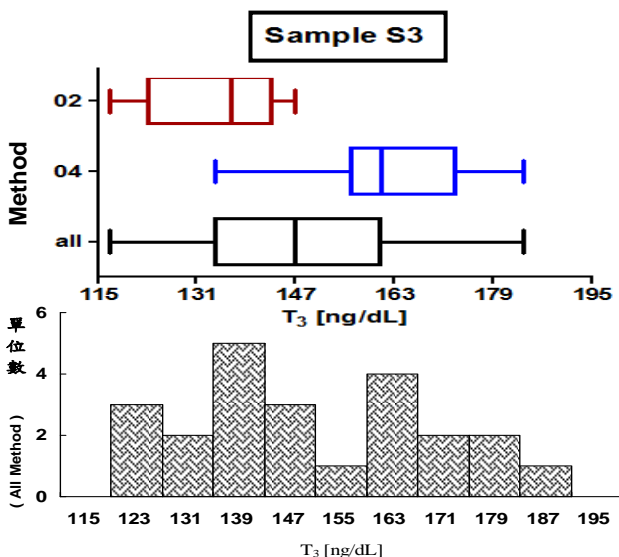

檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	12	137	133 (12)	11.0	8.3%
04	11	161	163 (11)	13.5	8.3%
All	23	147	147 (23)	19.4	13.2%

* Outlier(s) not included.