


100 年度 CHT 確診醫院第一次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-01

檢體寄出日期：100 年 2 月 21 日

報告截止日期：100 年 3 月 1 日


回收份數(比率)：23 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	30.4	30.8 (12)	2.30	7.5%
03	11	26.3	26.9 (11)	2.05	7.6%
All	23	29.0	28.9 (23)	2.93	10.1%


* Outlier(s) not included.



檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	12.2	12.4 (12)	1.02	8.3%
03	11	11.3	11.3 (11)	1.09	9.7%
All	23	12.0	11.9 (23)	1.17	9.9%

* Outlier(s) not included.

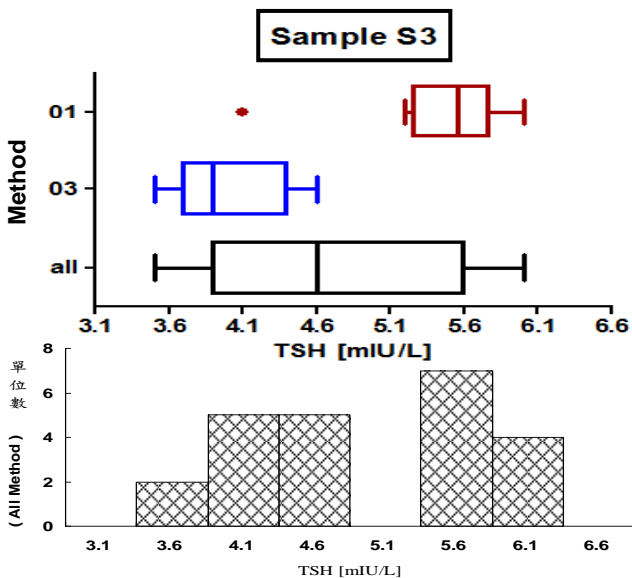

檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	5.6	5.6 (11)	0.26	4.8%
03	11	3.9	4.0 (11)	0.39	9.6%
All	23	4.6	4.8 (23)	0.84	17.6%

* Outlier(s) not included.