


# 100 年度 CHT 確診醫院第二次 FT<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2011-04

檢體寄出日期：100 年 4 月 25 日

報告截止日期：100 年 5 月 2 日


回收份數(比率)：22 份 (100%)



## 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.36	1.40 (10)	0.33	23.6%
04	12	1.35	1.36 (12)	0.15	10.8%
All	22	1.35	1.38 (22)	0.24	17.5%


\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.35	1.35 (10)	0.14	10.2%
04	12	1.25	1.22 (12)	0.17	13.7%
All	22	1.31	1.28 (22)	0.16	12.9%

\* Outlier(s) not included.

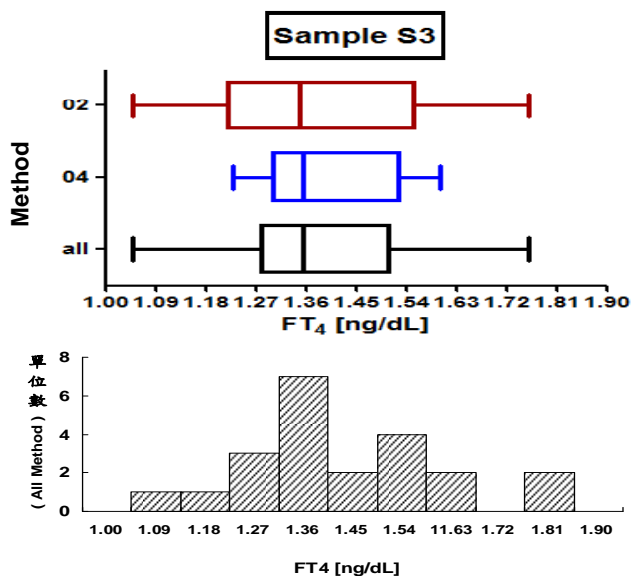

## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	1.35	1.39 (10)	0.23	16.8%
04	12	1.36	1.40 (12)	0.13	9.1%
All	22	1.36	1.40 (22)	0.18	12.8%

\* Outlier(s) not included.