



# 九十九年度 CHT 確診醫院第二次 T<sub>4</sub> 檢驗院際品管 統計分佈圖

送檢批號：CHT2010-09

檢體寄出日期：99年9月27日

報告截止日期：99年10月4日



回收份數(比率)：23份 (100%)

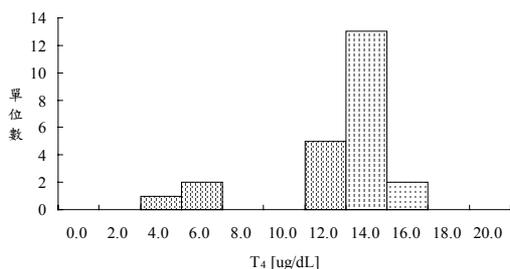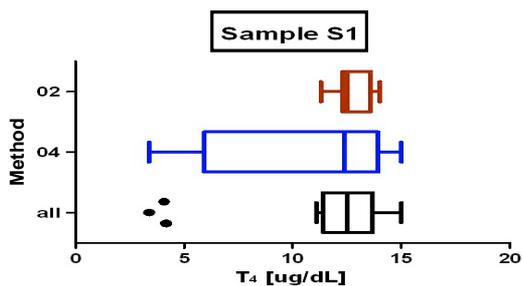

## 檢體 S1


Method	檢驗 單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	12.5	12.7 (11)	0.88	7.0%
04	12	12.4	10.8 (12)	4.29	39.9%
All	23	12.5	12.9 (20)	1.09	8.5%

\* Outlier not included.

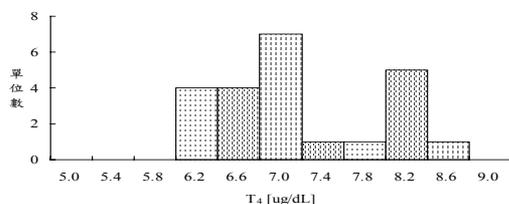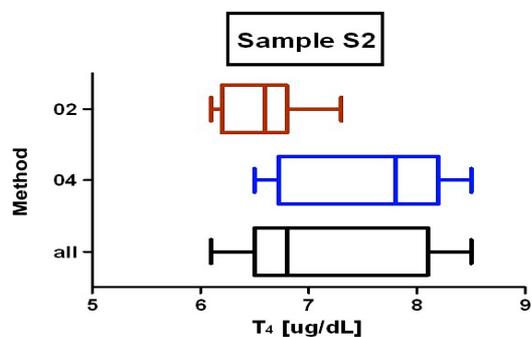

## 檢體 S2


Method	檢驗 單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.6	6.6 (11)	0.38	5.8%
04	12	7.8	7.5 (12)	0.77	10.2%
All	23	6.8	7.1 (23)	0.78	11.1%

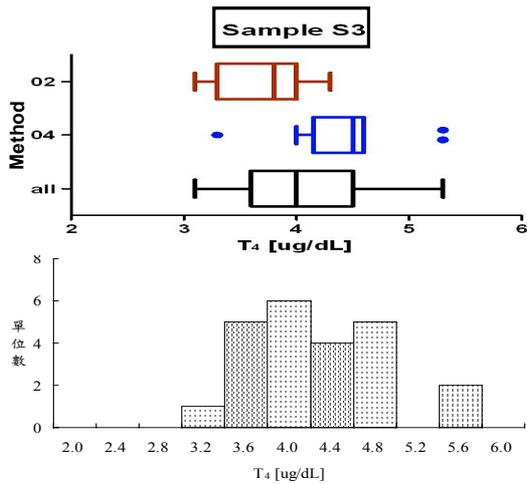

**檢體 S3**

Method	檢驗 單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	3.8	3.7 (11)	0.38	10.2%
04	12	4.5	4.4 (9)	0.22	5.1%
All	23	4.0	4.1 (23)	0.60	14.7%


\* Outlier not included.

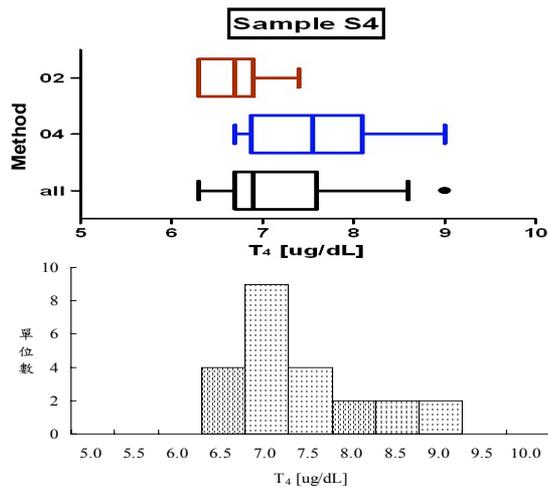

**檢體 S4**

Method	檢驗 單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.7	6.7 (11)	0.33	5.0%
04	12	7.6	7.6 (12)	0.74	9.8%
All	23	6.9	7.1 (22)	0.64	9.0%

\* Outlier not included.

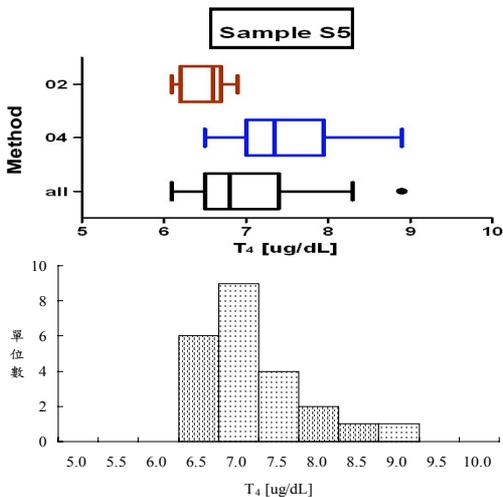

**檢體 S5**

Method	檢驗 單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)*	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	11	6.6	6.5 (11)	0.27	4.2%
04	12	7.4	7.5 (12)	0.68	9.1%
All	23	6.8	6.9 (22)	0.60	8.6%

\* Outlier not included.