


101 年度 CHT 確診醫院第二次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-04


檢體寄出日期：101 年 04 月 30 日

報告截止日期：101 年 05 月 07 日

回收份數(比率)：23 份 (100%)




檢體 S1



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	7.4	7.3 (11)	0.36	4.9%
03	11	6.2	6.2 (11)	0.41	6.6%
All	23	6.8	6.8 (23)	0.78	11.5%


* Outlier(s) not included.

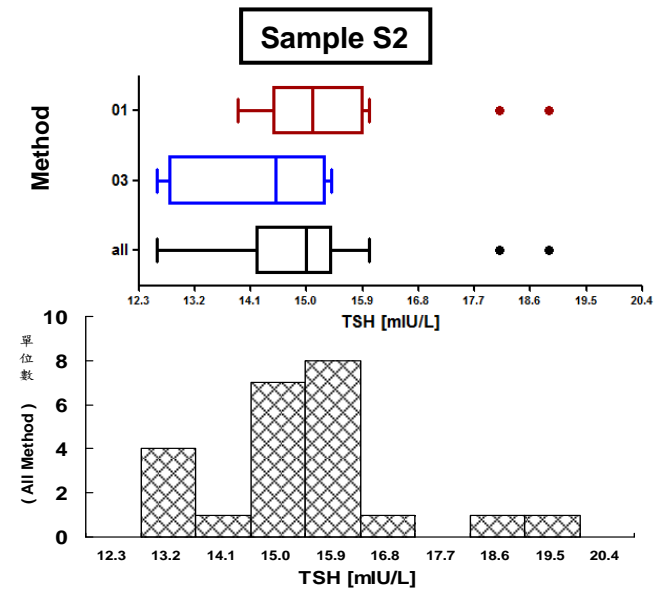

檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	15.1	15.0 (10)	0.65	4.3%
03	11	14.5	14.2 (11)	1.14	8.0%
All	23	15.0	14.5 (21)	1.00	6.9%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	12	52.2	53.5 (12)	5.39	10.1%
03	11	48.0	46.7 (11)	4.95	10.6%
All	23	51.6	50.2 (23)	6.12	12.2%

* Outlier(s) not included.