



# 101 年度 CHT 確診醫院第三次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-06

檢體寄出日期：101 年 06 月 25 日


報告截止日期：101 年 07 月 02 日

回收份數(比率)：22 份 (100%)

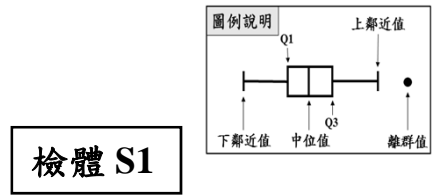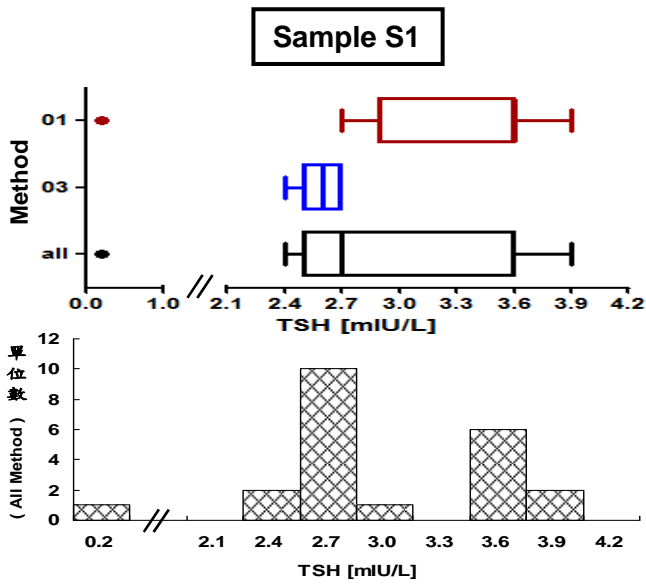

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	3.6	3.5 (10)	0.37	10.6%
03	11	2.6	2.6 (11)	0.12	4.6%
All	22	2.7	3.0 (21)	0.52	17.3%


\* Outlier(s) not included.

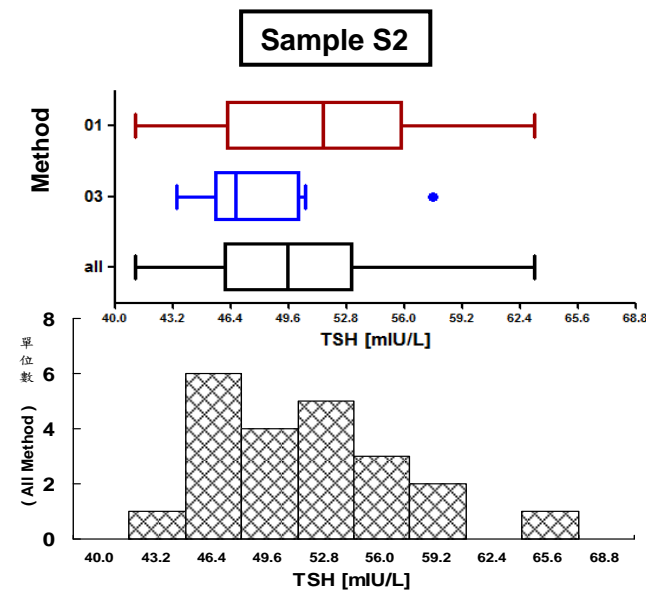

### 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	51.5	51.7 (11)	6.28	12.1%
03	11	46.7	47.2 (10)	2.60	5.5%
All	22	49.6	50.0 (22)	5.45	10.9%

\* Outlier(s) not included.

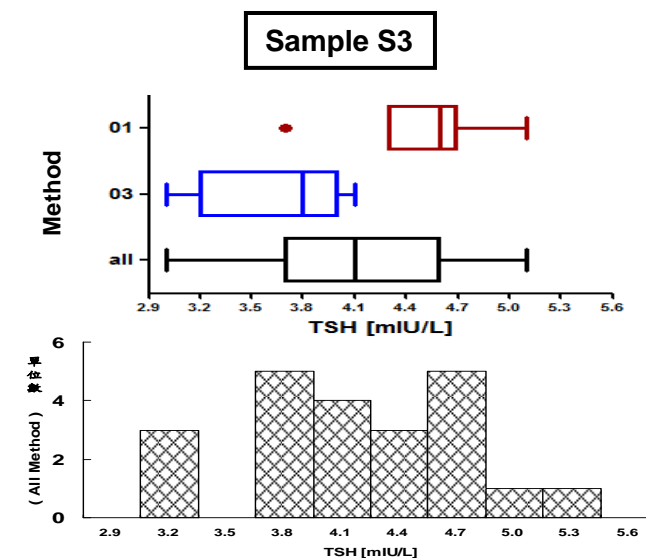

### 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	4.6	4.6 (10)	0.27	5.9%
03	11	3.8	3.7 (11)	0.4	10.8%
All	22	4.1	4.1 (22)	0.58	14.1%

\* Outlier(s) not included.