


101 年度 CHT 確診醫院第四次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2012-08


檢體寄出日期：101 年 08 月 27 日

報告截止日期：101 年 09 月 03 日

回收份數(比率)：22 份 (100%)




檢體 S1



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	14.9	15.4 (11)	1.74	11.3%
03	11	13.9	14.0 (11)	1.05	7.5%
All	22	14.6	14.4 (21)	1.17	8.1%


* Outlier(s) not included.

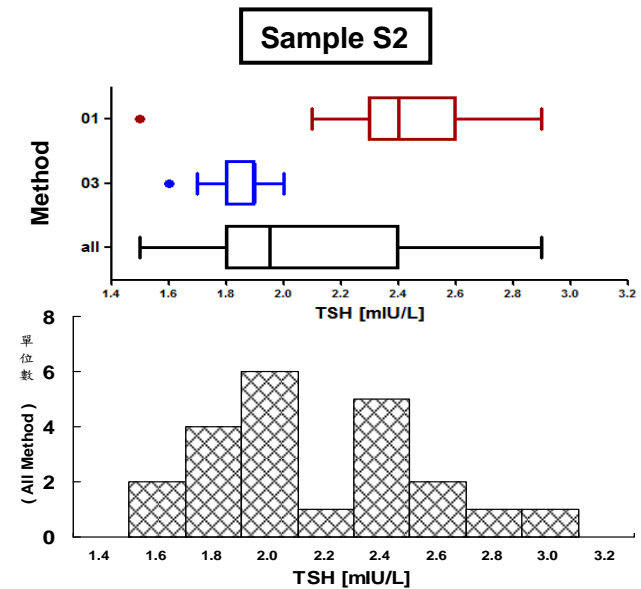

檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	2.4	2.5 (10)	0.22	8.8%
03	11	1.9	1.9 (10)	0.08	4.2%
All	22	2.0	2.1 (22)	0.38	18.1%

* Outlier(s) not included.



檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	11	80.8	82.0 (11)	11.6	14.1%
03	11	76.5	80.4 (11)	8.46	10.5%
All	22	78.7	81.2 (22)	9.94	12.2%

* Outlier(s) not included.