


102 年度 CHT 確診醫院第一次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-01


檢體寄出日期：102 年 01 月 14 日

報告截止日期：102 年 01 月 21 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)




檢體 S1



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	37.9	37.8 (10)	3.94	10.4%
03	11	30.6	30.5 (11)	3.21	10.5%
All	21	33.4	34.0 (21)	5.08	14.9%


* Outlier(s) not included.

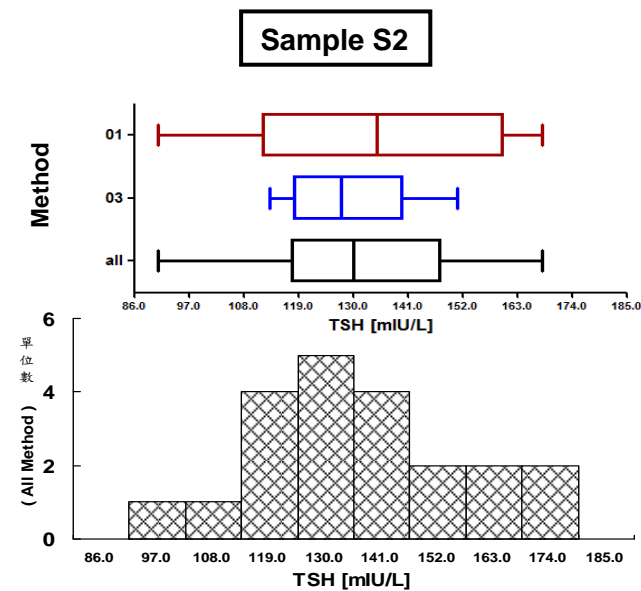

檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	134.9	135.3 (10)	26.55	19.6%
03	11	127.6	129.5 (11)	12.04	9.3%
All	21	130.0	132.3 (21)	19.96	15.1%

* Outlier(s) not included.

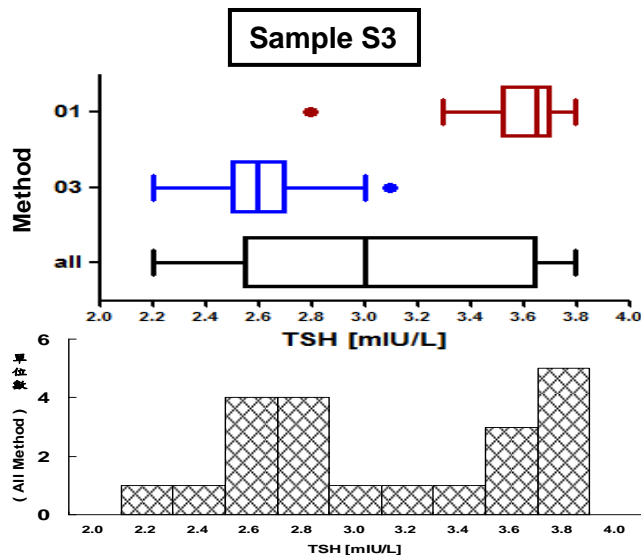

檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (n) (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	3.7	3.6 (9)	0.14	3.9%
03	11	2.6	2.6 (10)	0.21	8.1%
All	21	3.0	3.1 (21)	0.54	17.4%

* Outlier(s) not included.