



# 102 年度 CHT 確診醫院第二次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-04

檢體寄出日期：102 年 04 月 08 日

報告截止日期：102 年 04 月 15 日


回收份數(比率)：21 份 (100%)

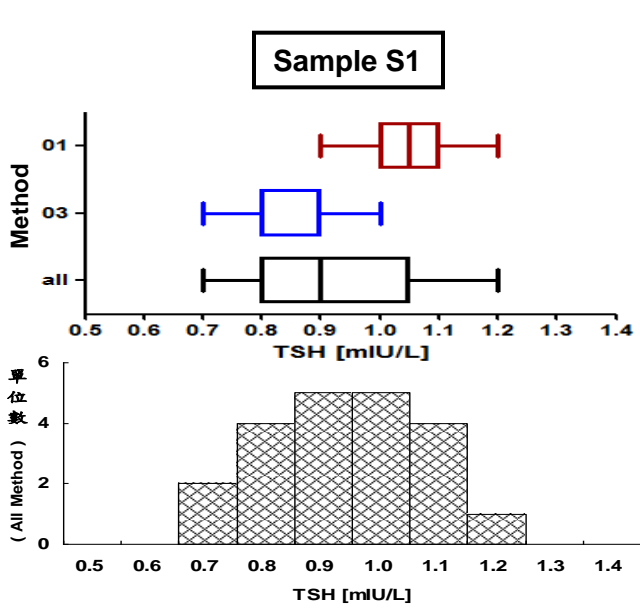

## 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	1.1	1.1 (10)	0.08	7.3%
03	11	0.8	0.8 (11)	0.09	11.3%
All	21	0.9	0.9 (21)	0.14	15.6%


\* Outlier(s) not included.

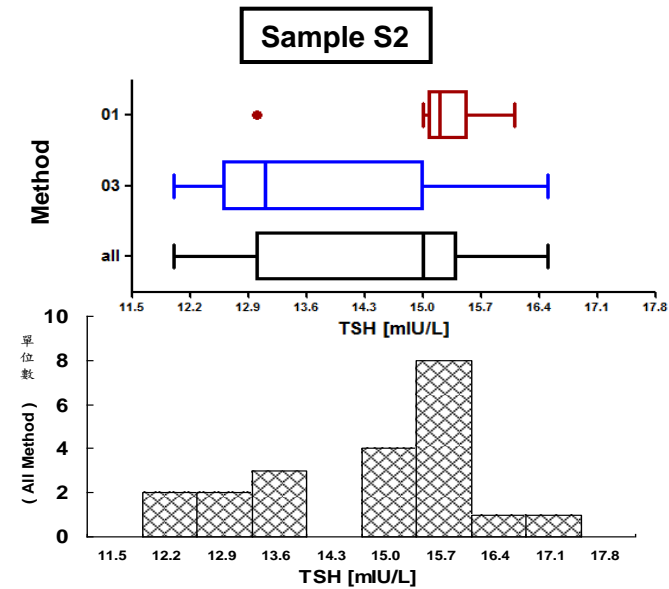

## 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	15.2	15.4 (9)	0.34	2.2%
03	11	13.1	13.8 (11)	1.51	10.9%
All	21	15.0	14.4 (21)	1.37	9.5%

\* Outlier(s) not included.

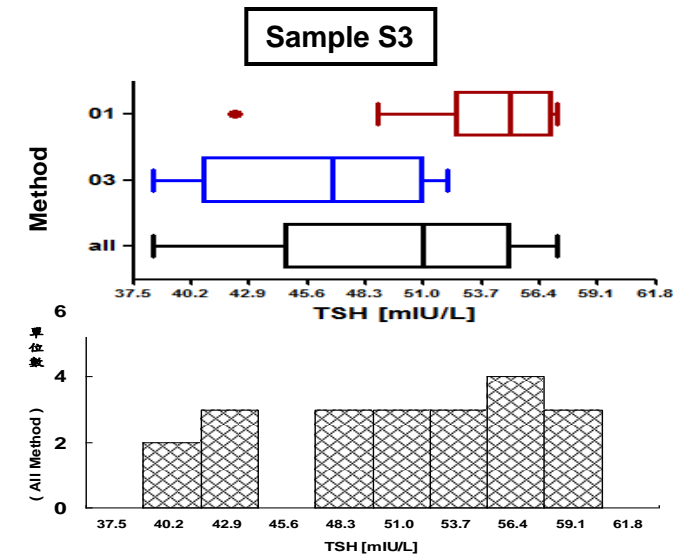

## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	55.1	55.0 (9)	2.56	4.7%
03	11	46.8	46.2 (11)	5.01	10.8%
All	21	51.0	49.8(21)	6.10	12.2%

\* Outlier(s) not included.