



# 102 年度 CHT 確診醫院第四次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2013-10      檢體寄出日期：102 年 10 月 21 日      報告截止日期：102 年 10 月 28 日


回收份數(比率)：21 份 (100%)



## 檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	7.9	7.9 (9)	0.36	4.6%
03	11	5.9	5.7 (11)	0.51	8.9%
All	21	6.2	6.7 (21)	1.19	17.8%


\* Outlier(s) not included.



## 檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	73.3	73.9 (10)	11.50	15.6%
03	11	59.8	62.1 (11)	9.16	14.8%
All	21	66.5	67.7 (21)	11.73	17.3%

\* Outlier(s) not included.

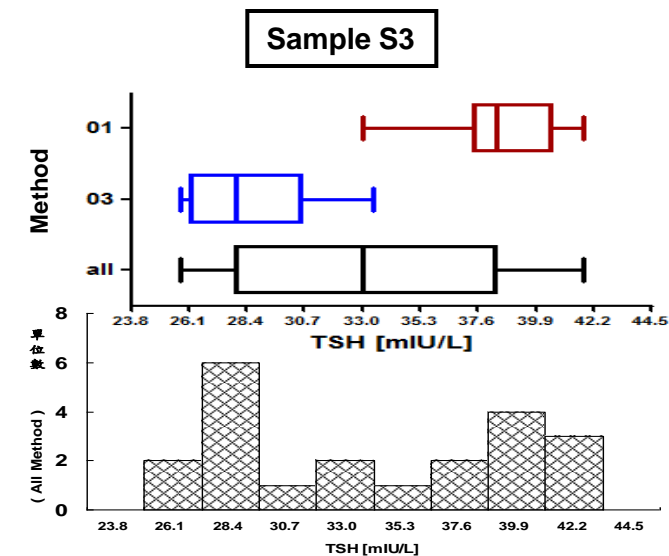

## 檢體 S3

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean) (n)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	38.3	38.4 (10)	2.45	6.4%
03	11	28.0	28.6 (11)	2.58	9.0%
All	21	33.0	33.2 (21)	5.58	16.8%

\* Outlier(s) not included.