



# CHT2014-02 批次 FT<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2014-02 檢體寄出日期：2014 年 02 月 24 日 報告截止日期：2014 年 03 月 03 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)




Sample S1

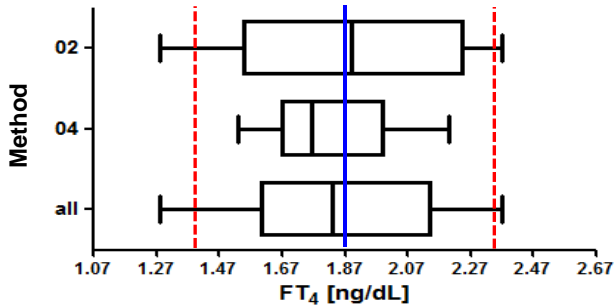

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.89	1.88*	0.45*	23.9%
04	12	1.77	1.82*	0.24*	13.2%
All	21	1.83	1.85*	0.33*	17.8%
AEL**	1146	1.87	1.85	0.23	12.4%

Sample S2

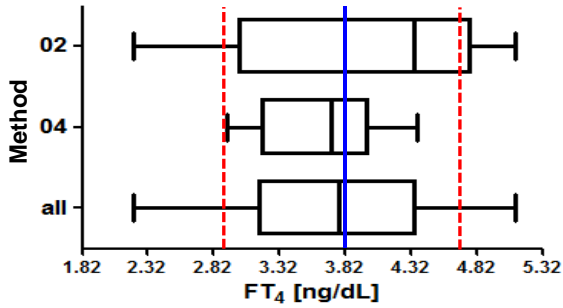


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	4.35	3.92*	1.16*	29.6%
04	12	3.72	3.65*	0.49*	13.4%
All	21	3.78	3.77*	0.77*	20.4%
AEL**	1146	3.82	3.77	0.59	15.5%


\* — Target, - - - MAD

\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* All European Laboratories

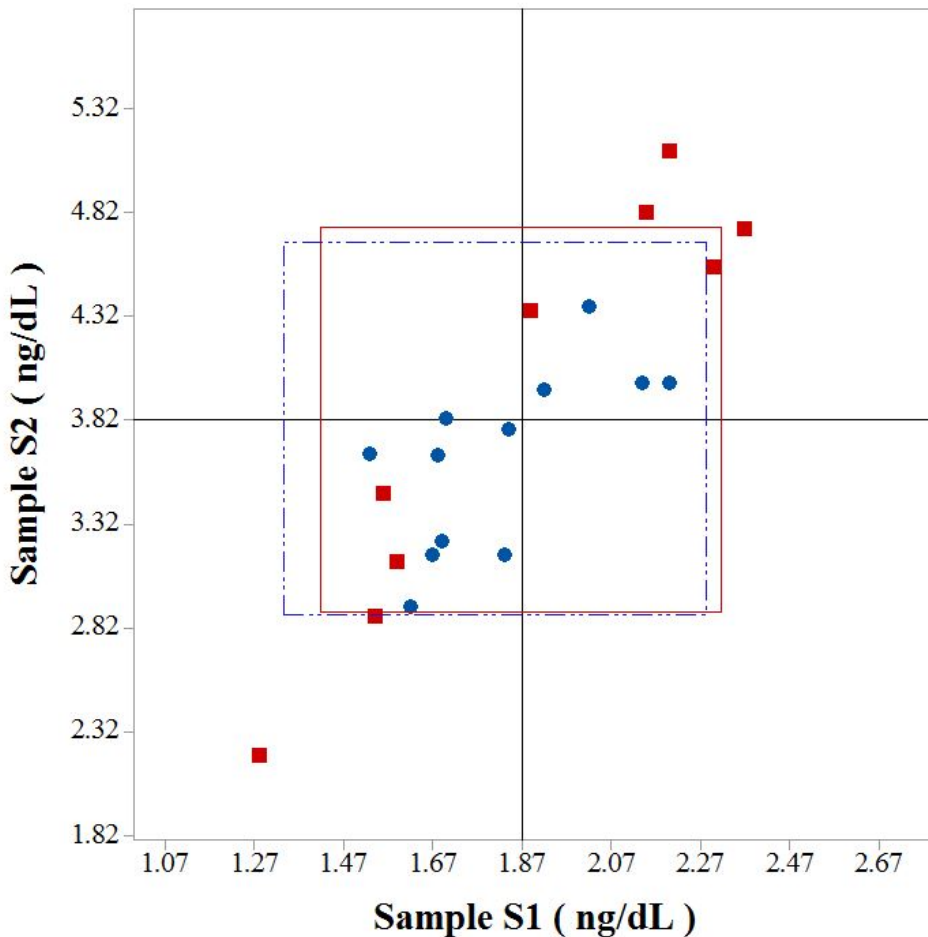

Youden Plot 圖例說明

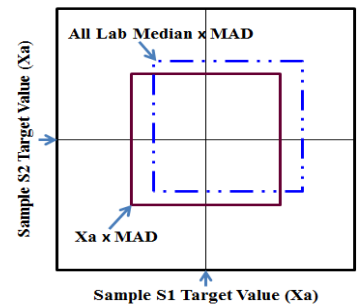

■ Method 02 ( RIA )

● Method 04 ( CLIA )

MAD : Maximum Allowable Deviation