



CHT2014-02 批次 T₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2014-02 檢驗寄出日期：2014年02月24日 報告截止日期：2014年03月03日
 回收份數(比率)：21份(100%)



Sample S1

檢體 S1

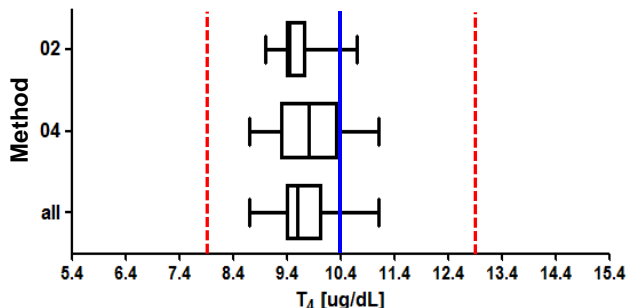


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	9.5	9.5*	0.33*	3.5%
04	13	9.8	9.9*	0.82*	8.3%
All	21	9.6	9.7*	0.63*	6.5%
AEL**	117	10.1	10.1	1.39	13.8%

Certified Target Value : 10.4 µg/dL

Sample S2

檢體 S2

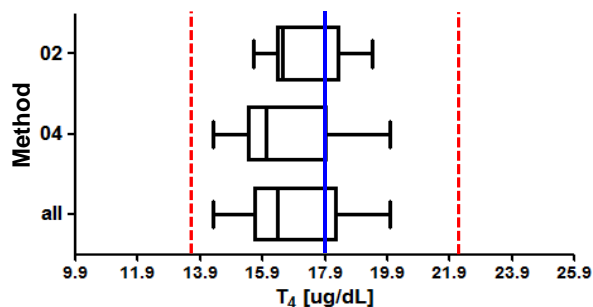


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	16.6	17.2*	1.48*	8.6%
04	13	16.0	16.6*	1.81*	10.9%
All	21	16.4	16.8*	1.69*	10.1%
AEL**	117	17.2	17.2	2.4	14.0%

Certified Target Value : 17.9 µg/dL


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Target, - - - MAD

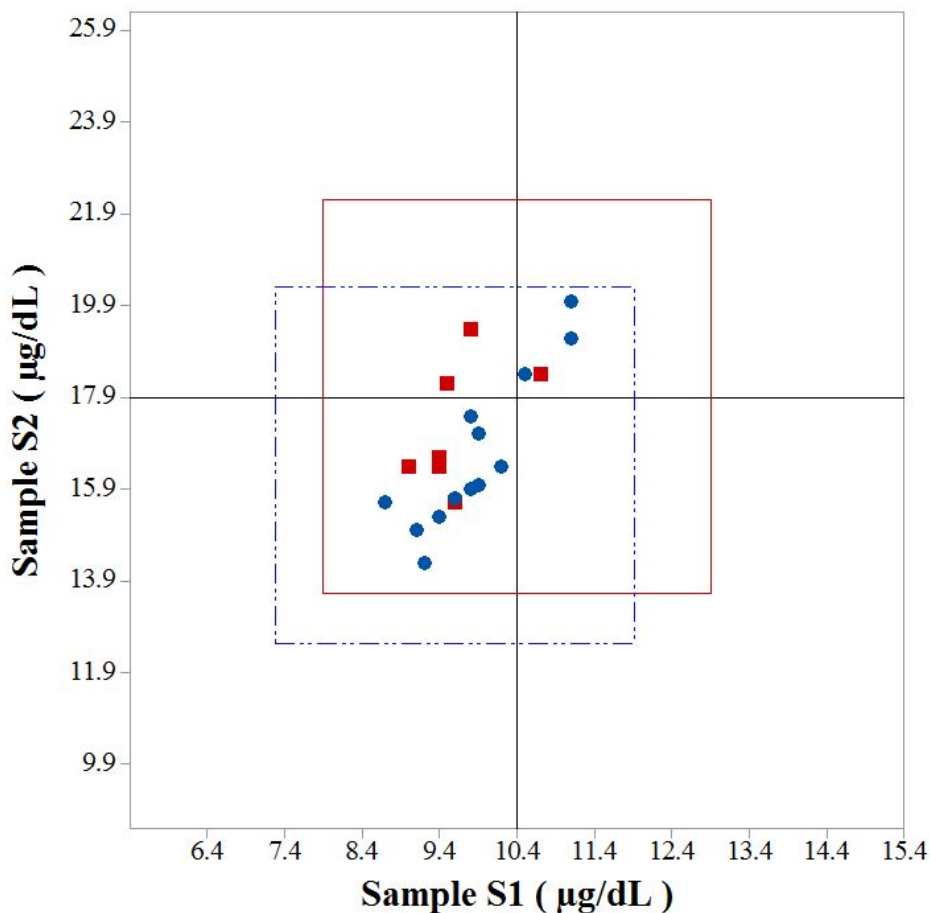

Youden Plot 圖例說明

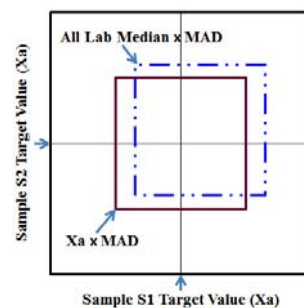

■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation