


CHT2014-04 批次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2014-04 檢體寄出日期：2014年04月21日 報告截止日期：2014年04月28日

回收份數(比率)：21份(100%)



Sample S1


檢體 S1

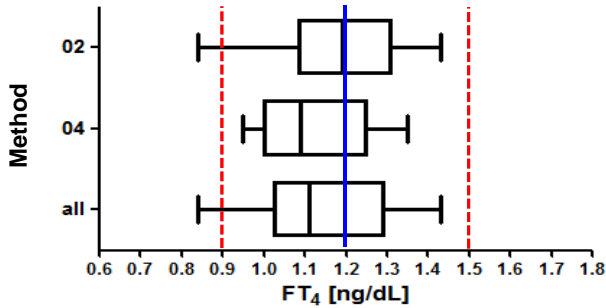

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.19	1.19*	0.18*	15.1%
04	12	1.09	1.12*	0.15*	13.4%
All	21	1.11	1.15*	0.16*	13.9%
AEL**	1171	1.20	1.17	0.16	13.5%

Sample S2

檢體 S2

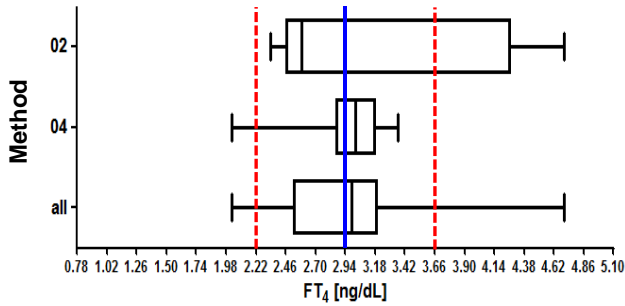


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	2.59	3.16*	1.09*	34.5%
04	12	3.03	3.01*	0.25*	8.3%
All	21	2.99	2.94*	0.56*	19.0%
AEL**	1137	2.94	2.88	0.45	15.5%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value, - - - MAD

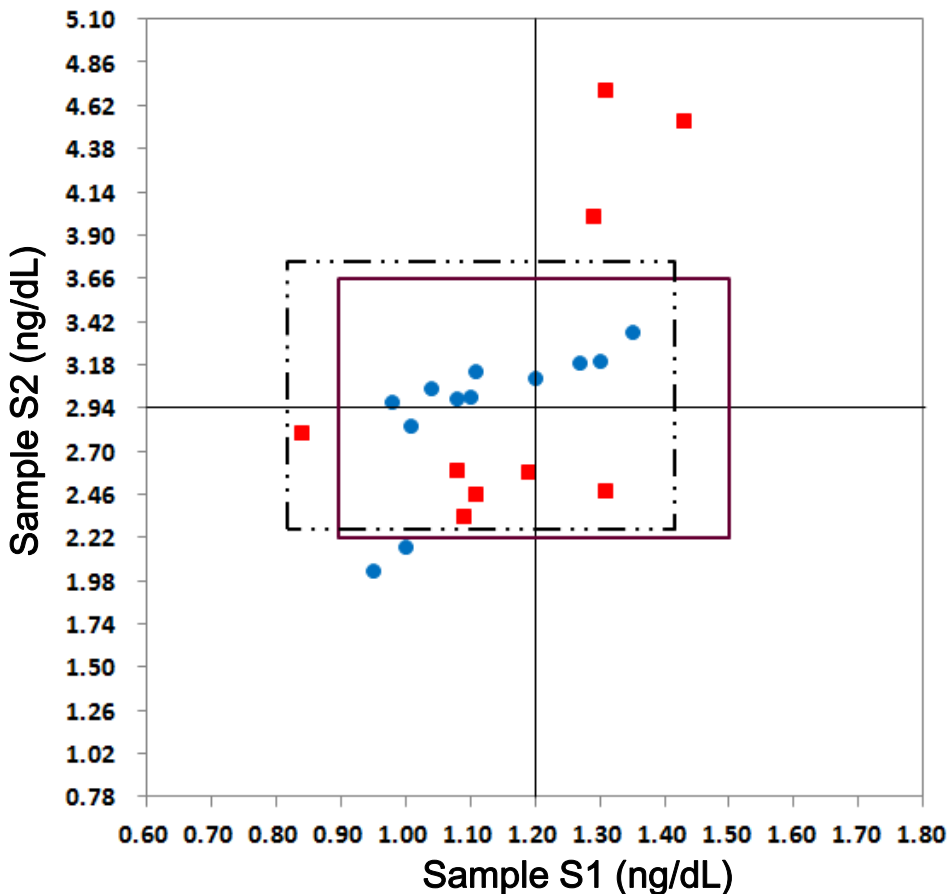

Youden Plot 圖例說明

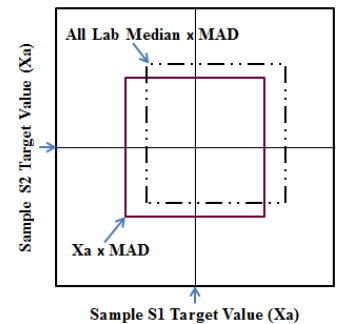

■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation