
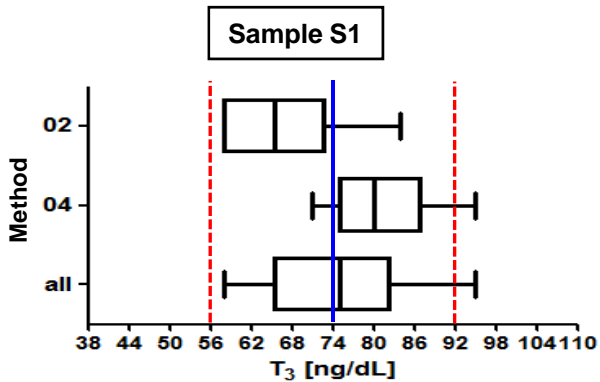


CHT2014-04 批次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2014-04 檢體寄出日期：2014年04月21日 報告截止日期：2014年04月28日


回收份數(比率)：21份(100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	66	66*	8.5*	12.9%
04	11	80	81*	8.4*	10.4%
All	21	75	74*	11.9*	16.1%
AEL**	138	96	93	14.4	15.5%

Certified assigned value : 74 ng/dL

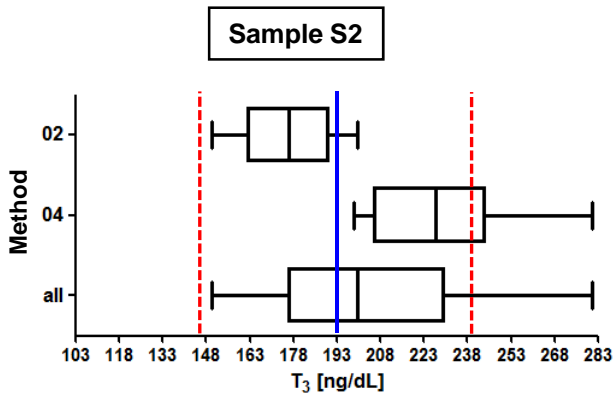

檢體 S2


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	177	176*	18.0*	10.2%
04	11	227	226*	23.5*	10.4%
All	21	200	202*	34.9*	17.3%
AEL**	147	242	245	31.1	12.7%

Certified assigned value : 193 ng/dL

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

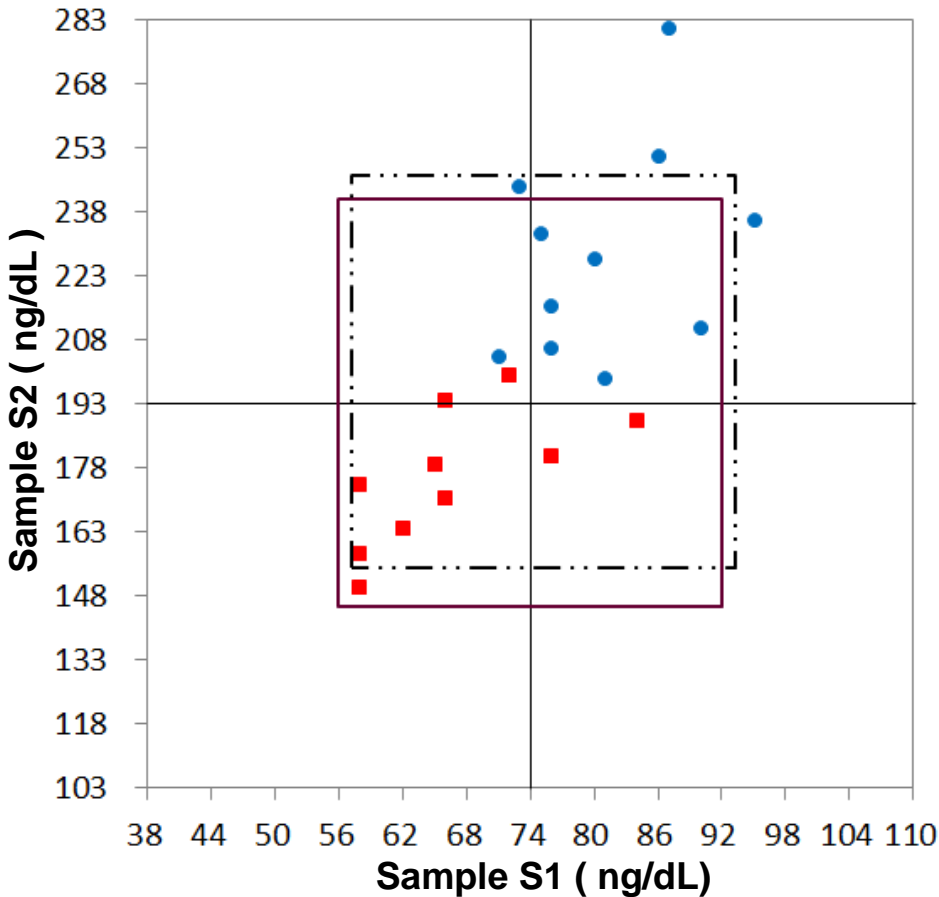

Youden Plot 圖例說明

