
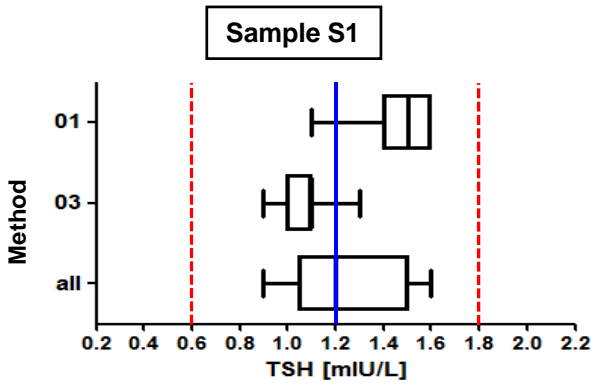


CHT2014-04 批次 TSH 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2014-04 檢體寄出日期：2014 年 04 月 21 日 報告截止日期：2014 年 04 月 28 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	1.5	1.5*	0.10*	6.7%
03	11	1.1	1.1*	0.13*	11.8%
All	21	1.2	1.3*	0.28*	21.5%
AEL**	1403	1.2	1.2	0.17	14.8%

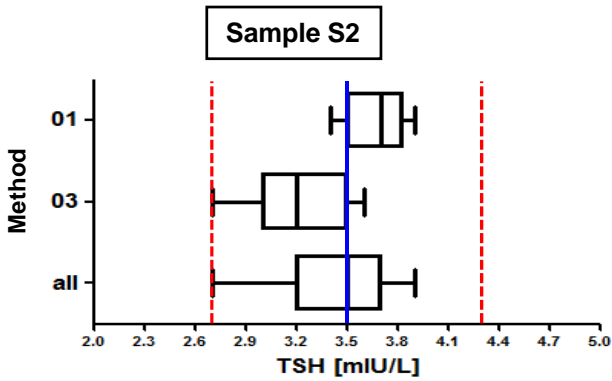


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
01	10	3.7	3.7*	0.19*	5.1%
03	11	3.2	3.3*	0.31*	9.4%
All	21	3.5	3.5*	0.33*	9.4%
AEL**	1373	3.5	3.4	0.39	11.4%

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

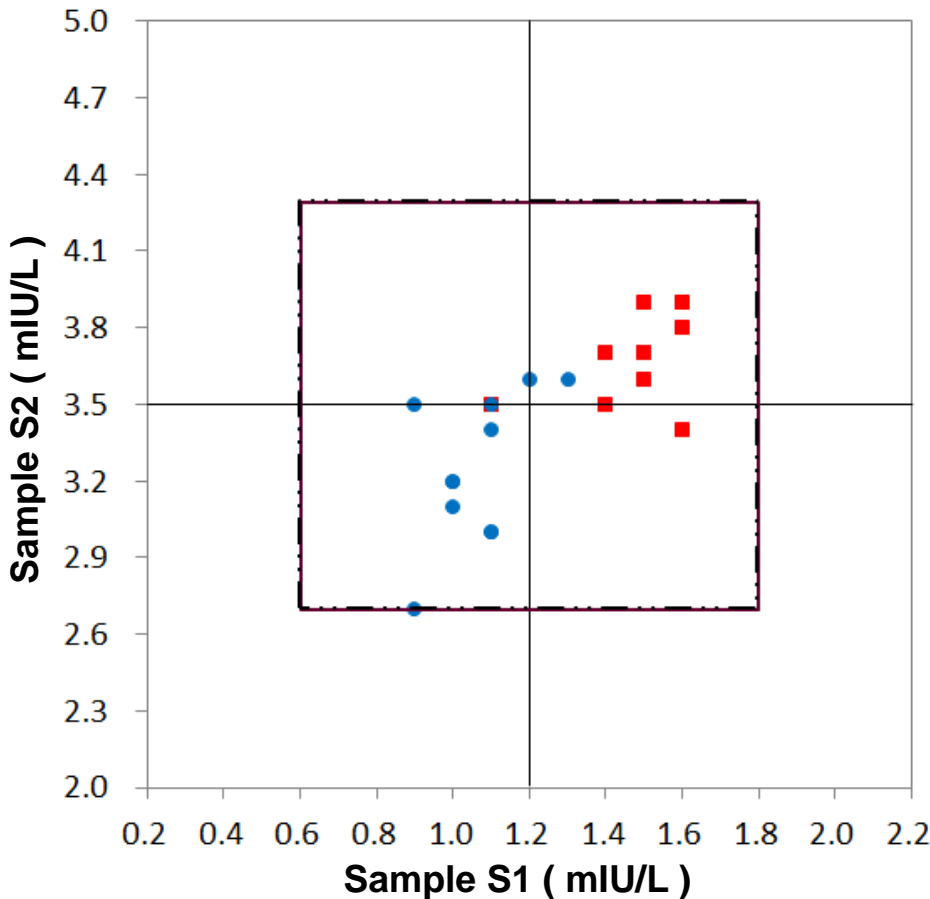

Youden Plot 圖例說明

