



CHT2014-07 批次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2014-07 檢體寄出日期：2014 年 07 月 21 日 報告截止日期：2014 年 07 月 28 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)




Sample S1

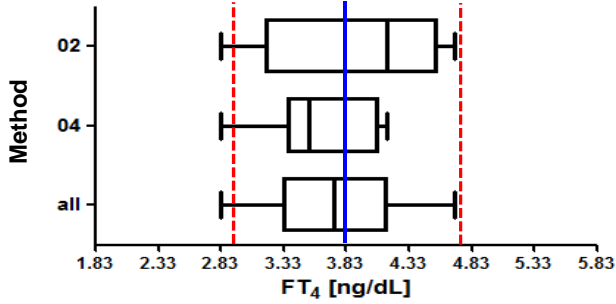

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	4.15	3.94*	0.08*	20.3%
04	12	3.53	3.62*	0.46*	12.7%
All	21	3.73	3.75*	0.64*	17.1%
AEL**	1149	3.83	3.77	0.58	15.4%

Sample S2

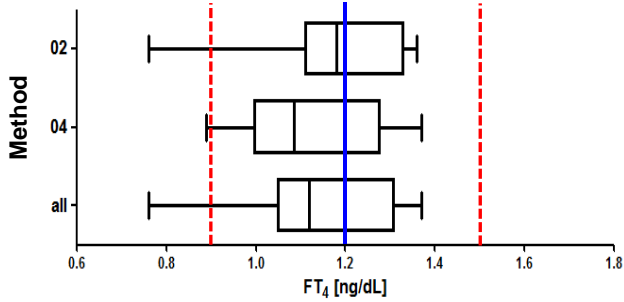


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.18	1.21*	0.15*	12.4%
04	12	1.09	1.11*	0.18*	16.2%
All	21	1.12	1.15*	0.18*	15.7%
AEL**	1171	1.20	1.17	0.16	13.5%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

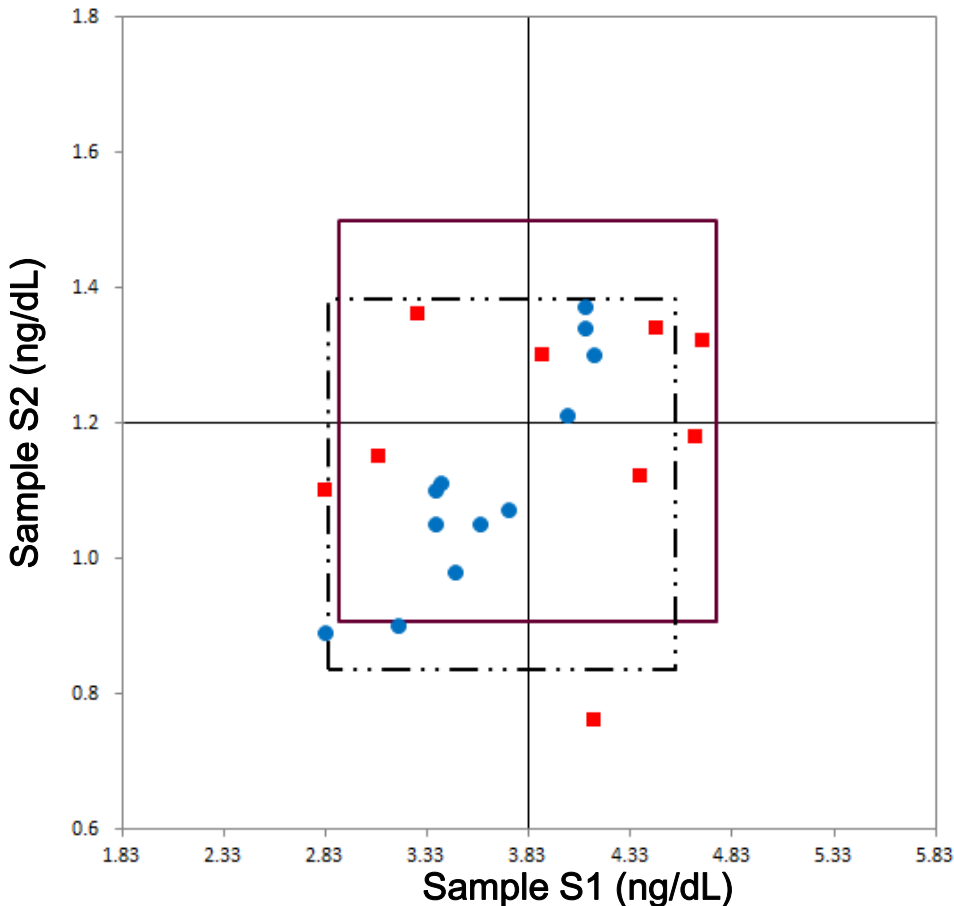

Youden Plot 圖例說明

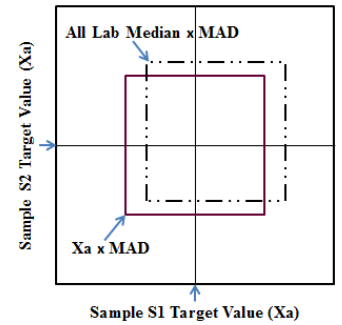

■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation