
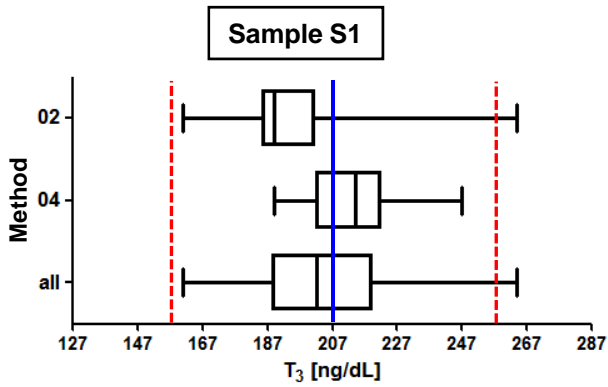


# CHT2014-07 批次 T<sub>3</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2014-07      檢體寄出日期：2014年07月21日      報告截止日期：2014年07月28日


回收份數(比率)：21份(100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	189	192*	13.3*	6.9%
04	11	214	215*	15.5*	7.2%
All	21	202	205*	20.8*	10.1%
AEL**	143	232	229	42.6	18.7%

Certified assigned value : 207 ng/dL

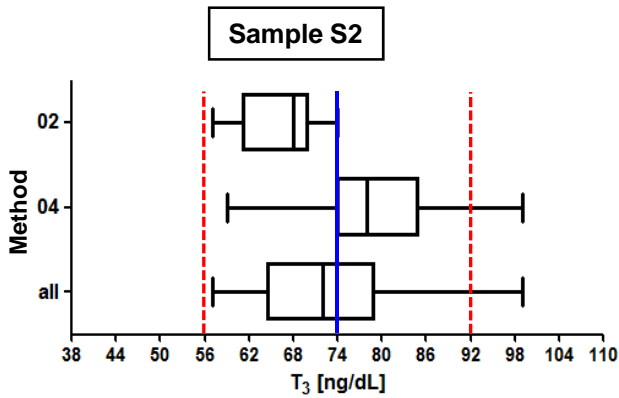

檢體 S2


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	68	66*	6.4*	9.7%
04	11	78	80*	10.3*	12.9%
All	21	72	72*	10.7*	14.9%
AEL**	138	96	93	14.4	15.5%

Certified assigned value : 74 ng/dL


\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* All European Laboratories

\* — Assigned value , - - - MAD

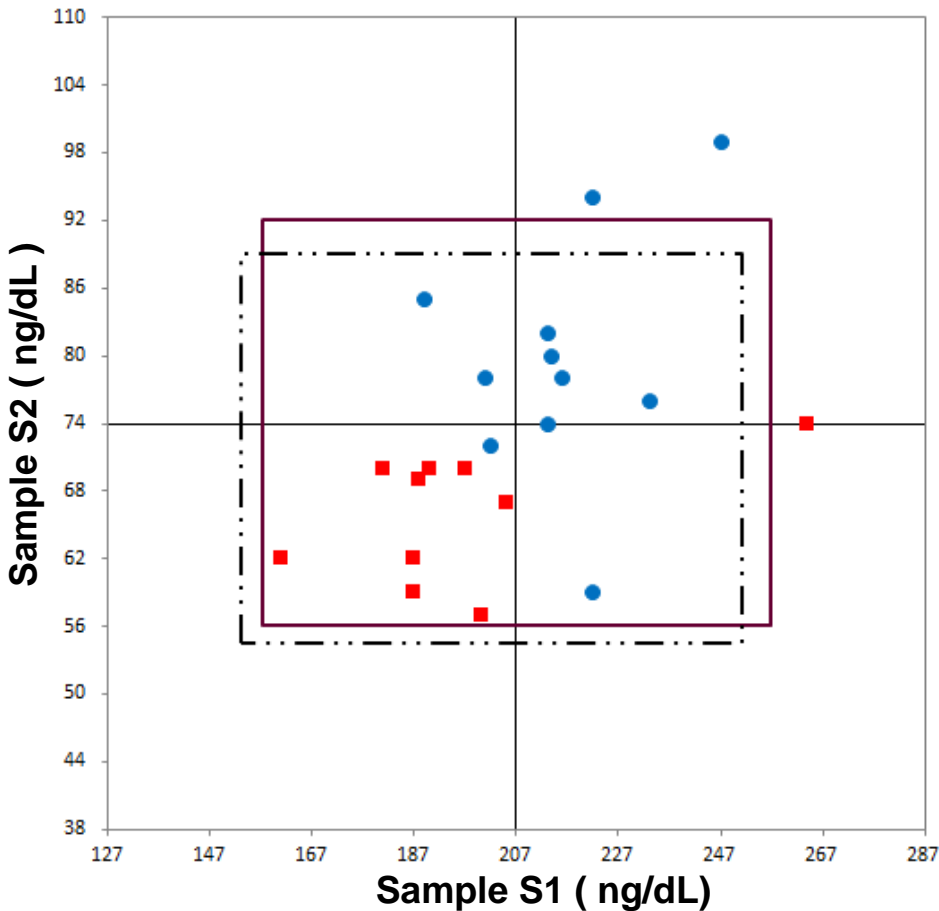

Youden Plot 圖例說明

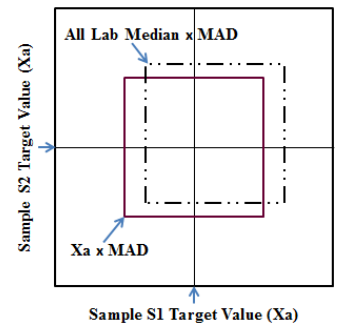

■ Method 02 ( RIA )

● Method 04 ( CLIA )

MAD : Maximum Allowable Deviation