


CHT2014-10 批次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2014-10 檢體寄出日期：2014 年 10 月 01 日 報告截止日期：2014 年 10 月 08 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1


檢體 S1

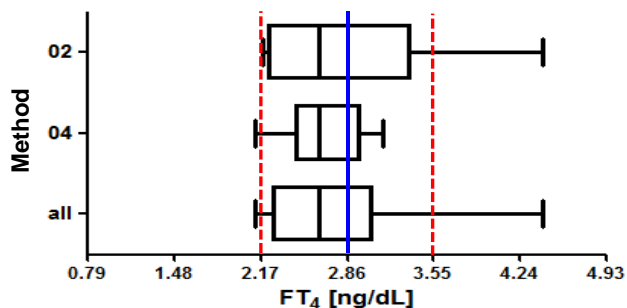

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	2.63	2.81*	0.72*	25.6%
04	12	2.64	2.64*	0.37*	14.0%
All	21	2.63	2.69*	0.48*	17.8%
AEL**	1197	2.86	2.74	0.44	16.0%

Sample S2

檢體 S2

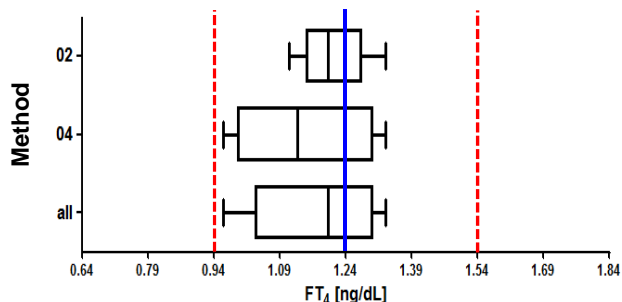


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.20	1.21*	0.08*	6.6%
04	12	1.13	1.14*	0.17*	14.9%
All	21	1.20	1.17*	0.14*	12.0%
AEL**	1197	1.24	1.19	0.16	13.1%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

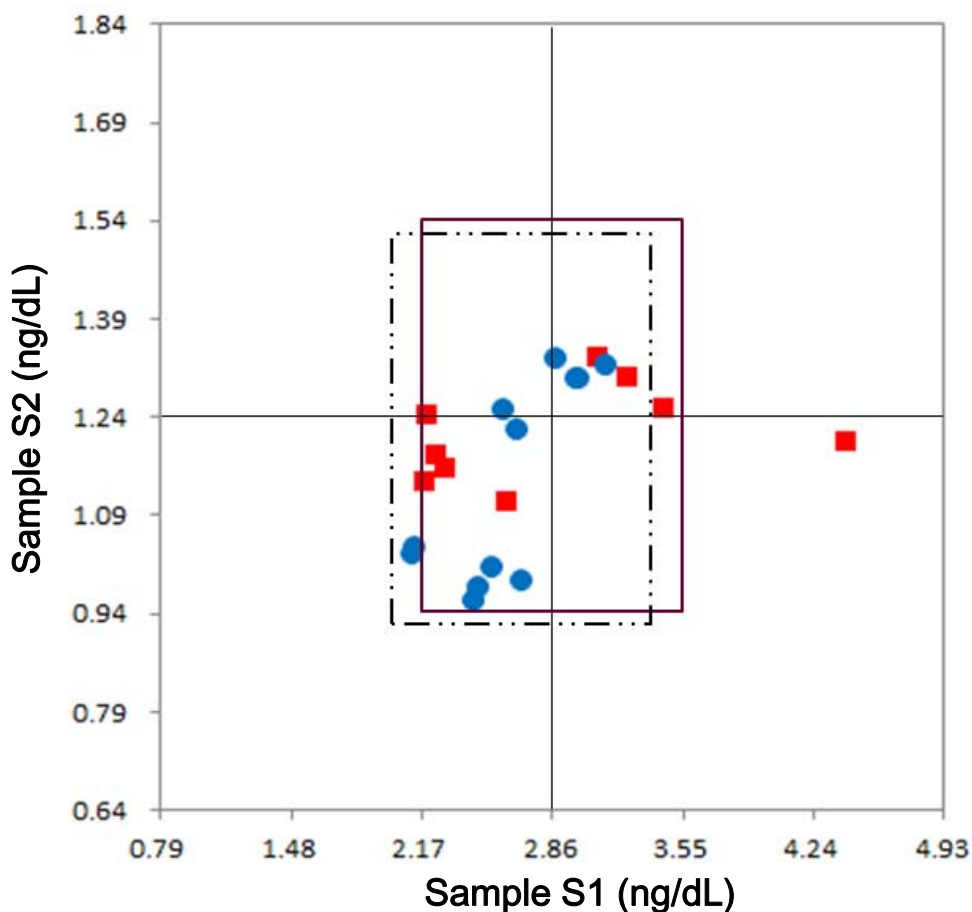

Youden Plot 圖例說明

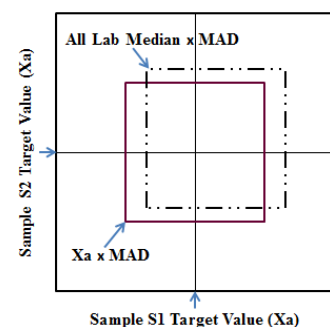

■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation