
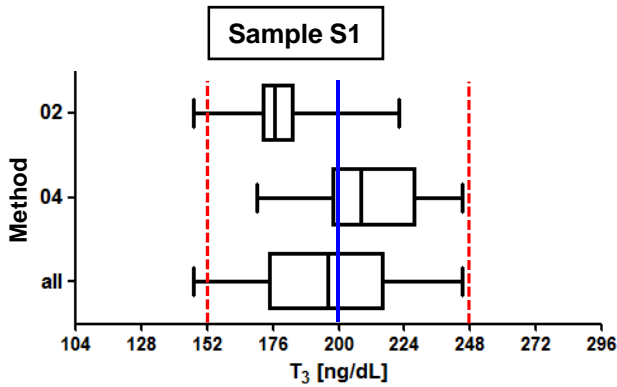


CHT2014-10 批次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2014-10 檢體寄出日期：2014年10月01日 報告截止日期：2014年10月08日


回收份數(比率)：21份(100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	177	177*	5.4*	3.1%
04	11	208	212*	22.4*	10.6%
All	21	196	196*	27.5*	14.0%
AEL**	152	228	226	22.5	10.0%

Certified assigned value : 200 ng/dL

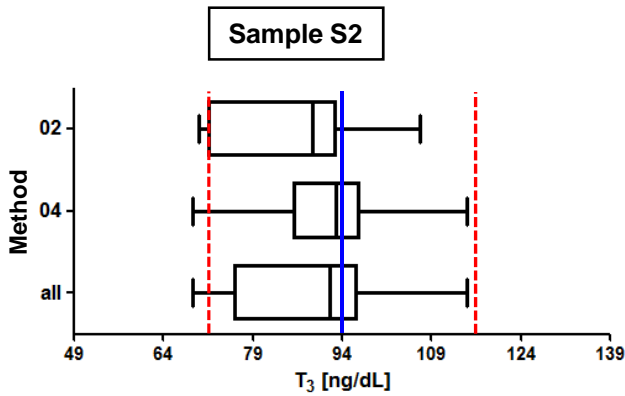

檢體 S2


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	89	85*	14.2*	16.7%
04	11	93	90*	11.7*	13.0%
All	21	92	88*	13.2*	15.0%
AEL**	152	104	102	16.1	15.8%

Certified assigned value : 94 ng/dL

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

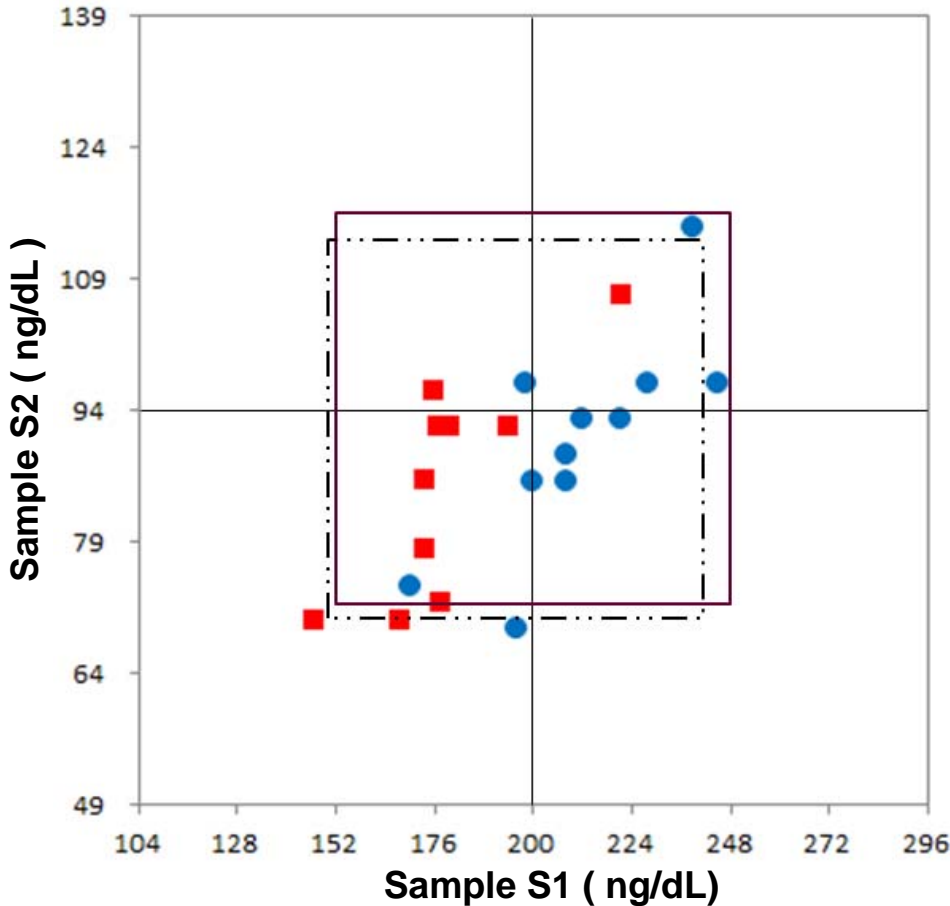

Youden Plot 圖例說明

