


CHT2015-04 批次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖


送檢批號：CHT2015-04 檢體寄出日期：2015 年 04 月 27 日 報告截止日期：2015 年 05 月 04 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1


檢體 S1

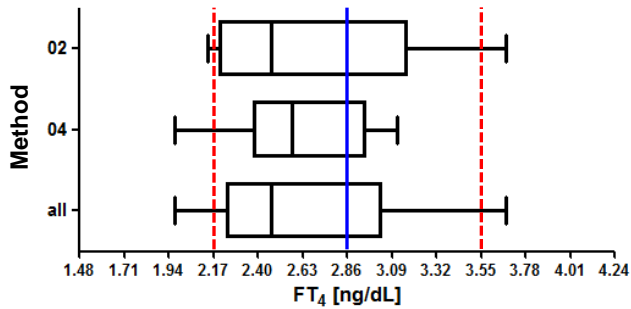

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	2.47	2.71*	0.64*	23.6%
04	12	2.58	2.59*	0.42*	16.2%
All	21	2.47	2.62*	0.48*	18.3%
AEL**	1197	2.86	2.74	0.44	16.0%

Sample S2

檢體 S2

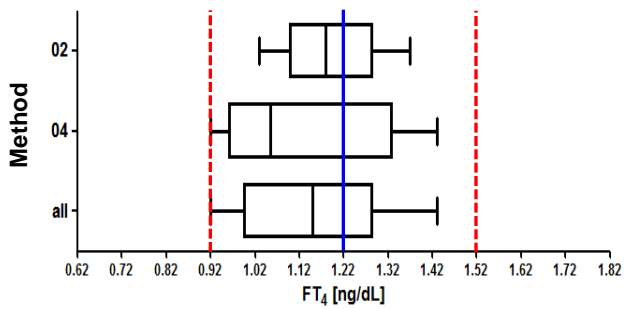


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.18	1.19*	0.12*	10.1%
04	12	1.06	1.12*	0.22*	19.6%
All	21	1.15	1.15*	0.18*	15.7%
AEL**	1199	1.22	1.18	0.14	11.8%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

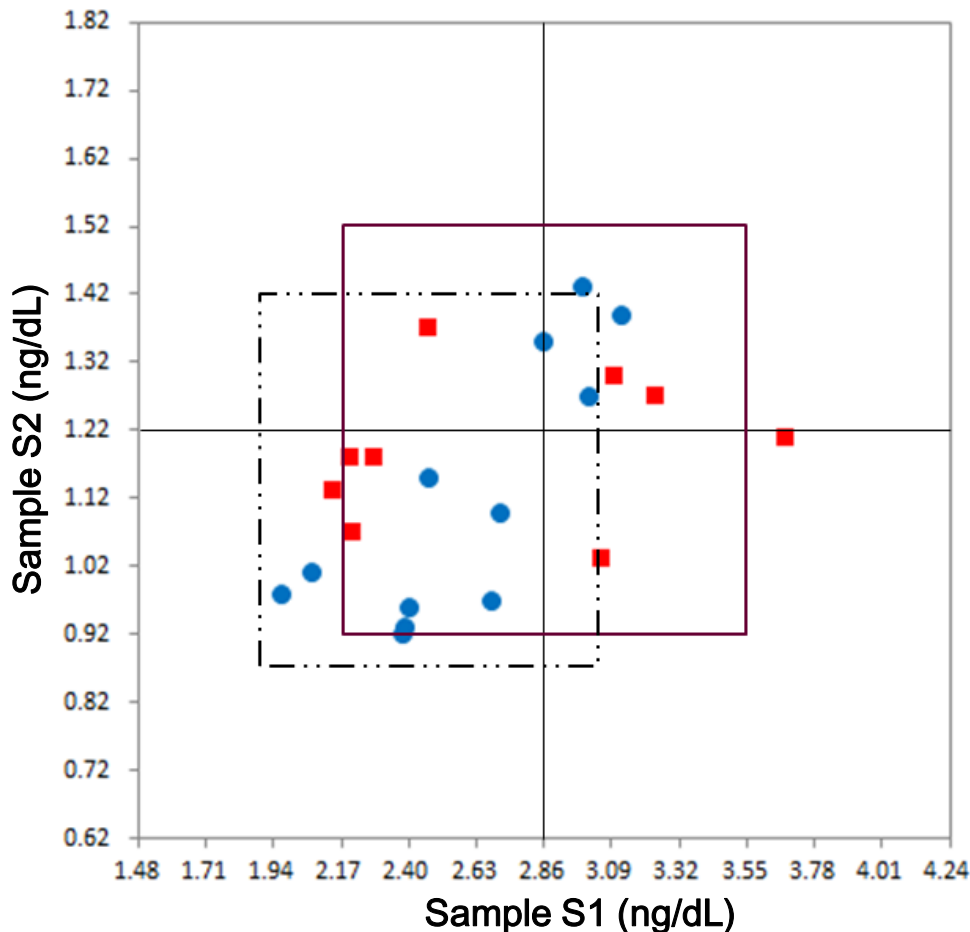

Youden Plot 圖例說明

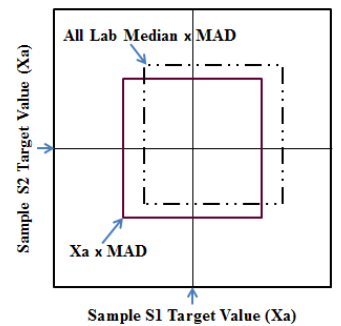

■ Method 02 (RIA)
 ● Method 04 (CLIA)
 MAD : Maximum Allowable Deviation