



CHT2015-04 批次 T₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2015-04 檢體寄出日期：2015 年 04 月 27 日 報告截止日期：2015 年 05 月 04 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1

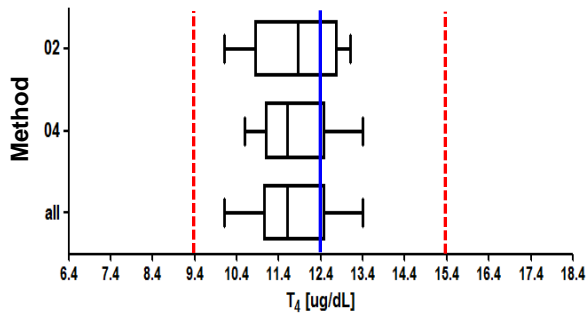


檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	11.9	11.8*	1.21*	10.3%
04	13	11.6	11.7*	0.87*	7.4%
All	21	11.6	11.7*	1.00*	8.5%
AEI**	117	12.0	12.2	1.49	12.2%

Certified assigned value : 12.4 $\mu\text{g/dL}$

Sample S2

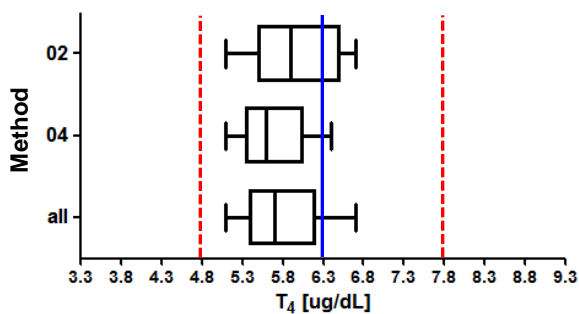

* — Assigned value , - - - MAD


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	5.9	5.9*	0.64*	10.8%
04	13	5.6	5.7*	0.49*	8.6%
All	21	5.7	5.8*	0.53*	9.1%
AEI**	107	6.2	6.2	0.63	10.3%


Certified assigned value : 6.3 $\mu\text{g/dL}$

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

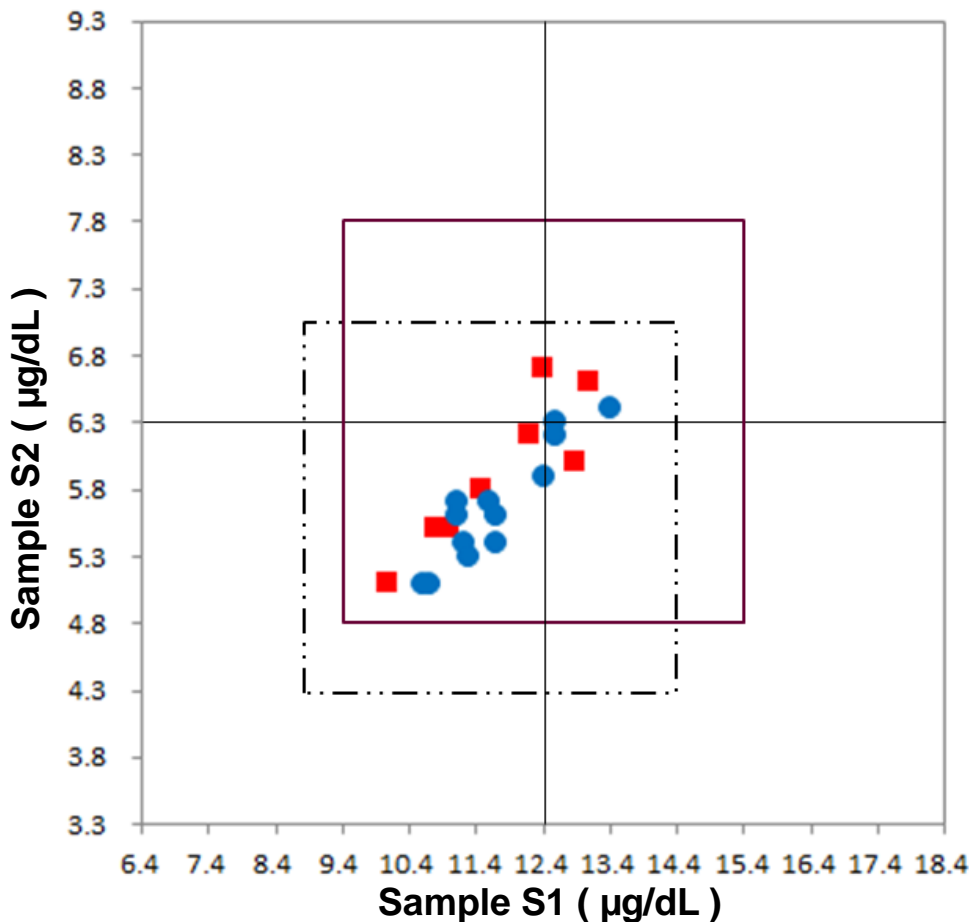

Youden Plot 圖例說明

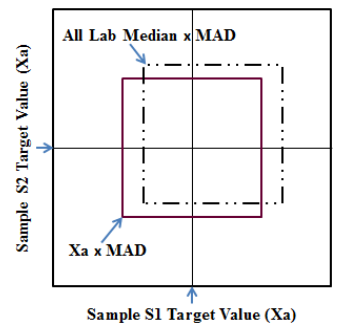

■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation