



# CHT2015-10 批次 FT<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2015-10 檢體寄出日期：2015 年 10 月 26 日 報告截止日期：2015 年 11 月 02 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)




Sample S1

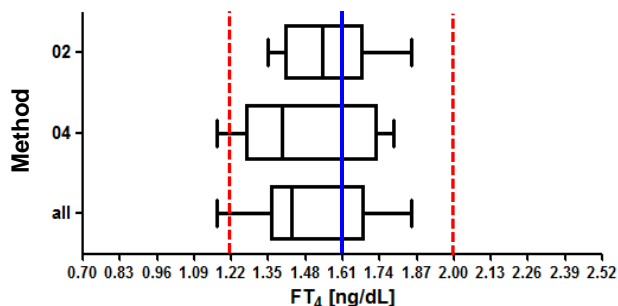

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.54	1.55*	0.17*	11.0%
04	12	1.40	1.46*	0.26*	17.8%
All	21	1.43	1.50*	0.23*	15.3%
AEL**	1196	1.61	1.54	0.21	13.8%

Sample S2

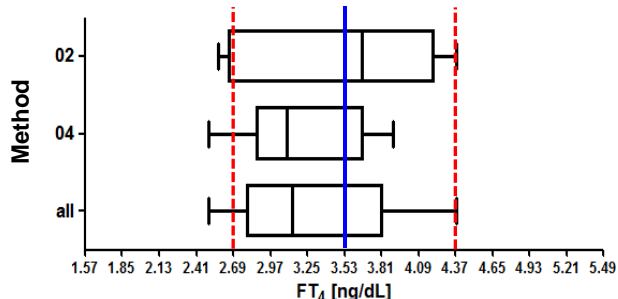


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	3.66	3.46*	0.86*	24.9%
04	12	3.10	3.22*	0.51*	15.8%
All	21	3.14	3.32*	0.68*	20.5%
AEL**	1196	3.53	3.38	0.55	16.1%


\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* All European Laboratories

\* — Assigned value , - - - MAD

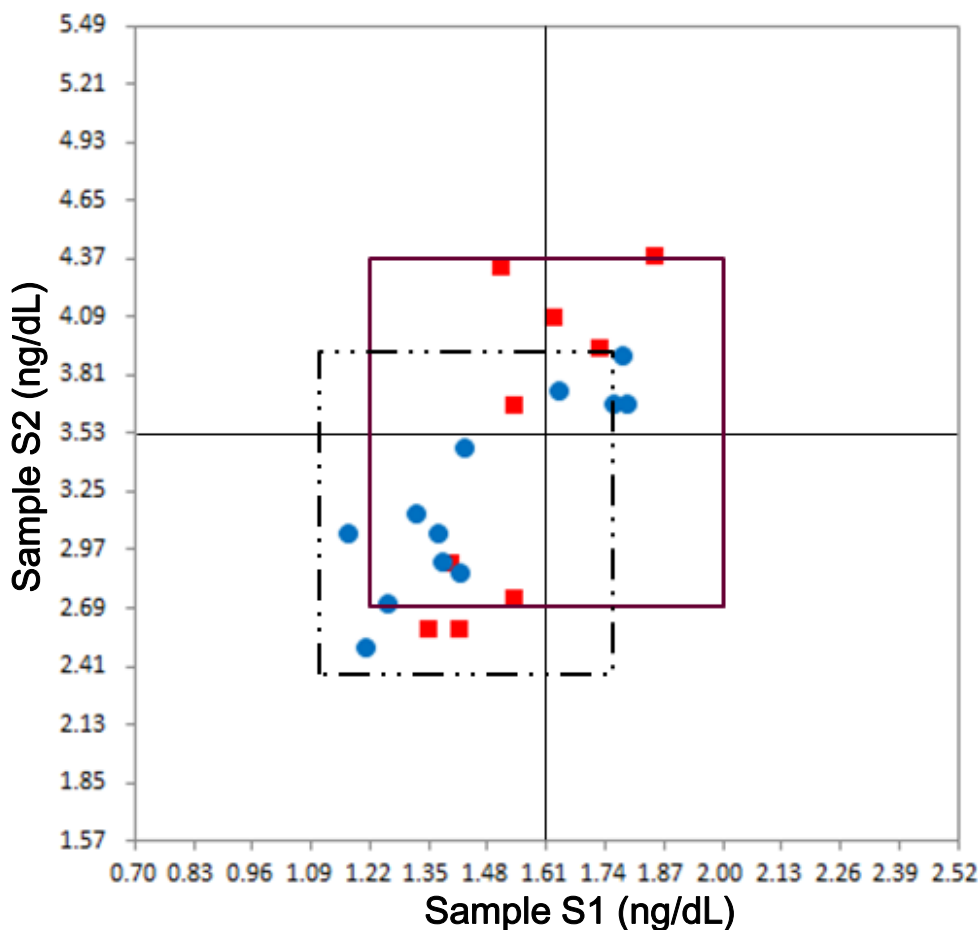

Youden Plot 圖例說明

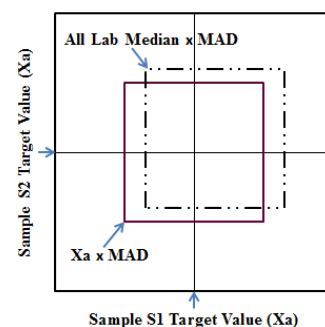

■ Method 02 ( RIA )

● Method 04 ( CLIA )

MAD : Maximum Allowable Deviation