



CHT2015-10 批次 T₃ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2015-10 檢體寄出日期：2015 年 10 月 26 日 報告截止日期：2015 年 11 月 02 日


回收份數(比率)：21 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	167	166*	18.8*	11.3%
04	11	173	180*	20.2*	11.2%
All	21	172	173*	19.8*	11.4%
AEL**	141	189	187	21.8	11.6%

Certified assigned value : 169 ng/dL



檢體 S2


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	244	240*	15.4*	6.4%
04	11	248	247*	27.2*	11.0%
All	21	245	243*	19.6*	8.1%
AEL**	141	273	271	33.8	12.5%

Certified assigned value : 240 ng/dL


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

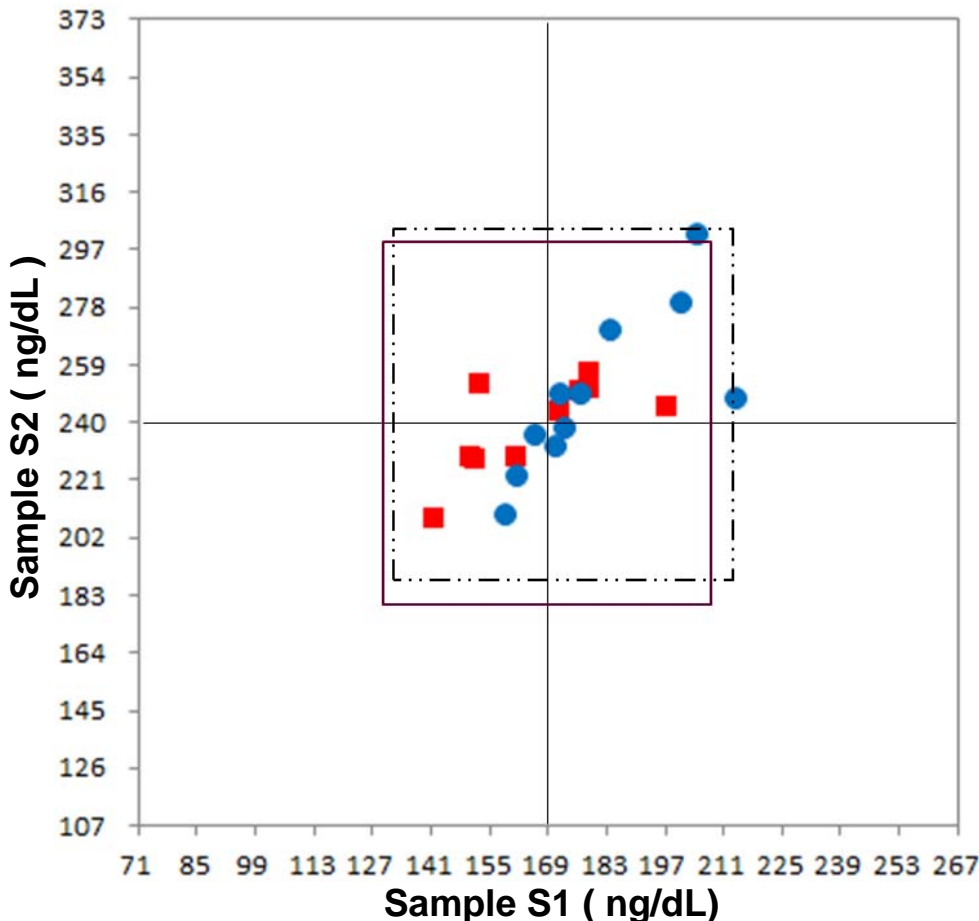

Youden Plot 圖例說明



■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation