



CHT2016-01 批次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2016-01 檢體寄出日期：2016 年 02 月 22 日 報告截止日期：2016 年 02 月 29 日
回收份數(比率)：21 份 (100%)




Sample S1

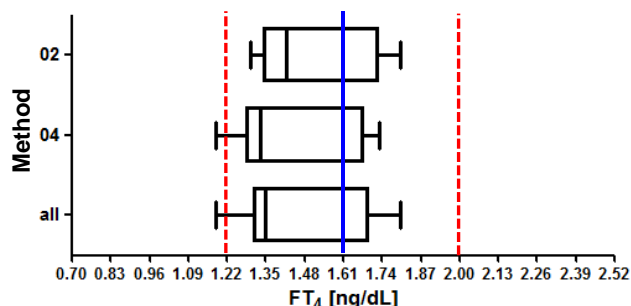

檢體 S1

| Method | 檢驗 單位數 | 中位值 (Median) | 平均值 (Mean) | 標準差 (SD) | 變異係數 (CV) |
|--------|-----------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 02 | 9 | 1.42 | 1.52* | 0.23* | 15.1% |
| 04 | 12 | 1.33 | 1.42* | 0.24* | 16.9% |
| All | 21 | 1.35 | 1.46* | 0.23* | 15.8% |
| AEL** | 1196 | 1.61 | 1.54 | 0.21 | 13.8% |

Sample S2

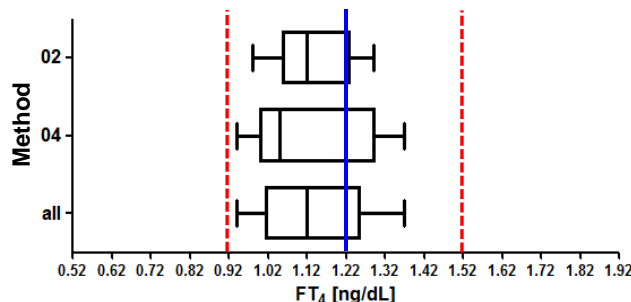


檢體 S2

| Method | 檢驗 單位數 | 中位值 (Median) | 平均值 (Mean) | 標準差 (SD) | 變異係數 (CV) |
|--------|-----------|-----------------|---------------|-------------|--------------|
| 02 | 9 | 1.12 | 1.14* | 0.11* | 9.6% |
| 04 | 12 | 1.05 | 1.12* | 0.17* | 15.2% |
| All | 21 | 1.12 | 1.13* | 0.15* | 13.3% |
| AEL** | 1199 | 1.22 | 1.18 | 0.14 | 11.8% |


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

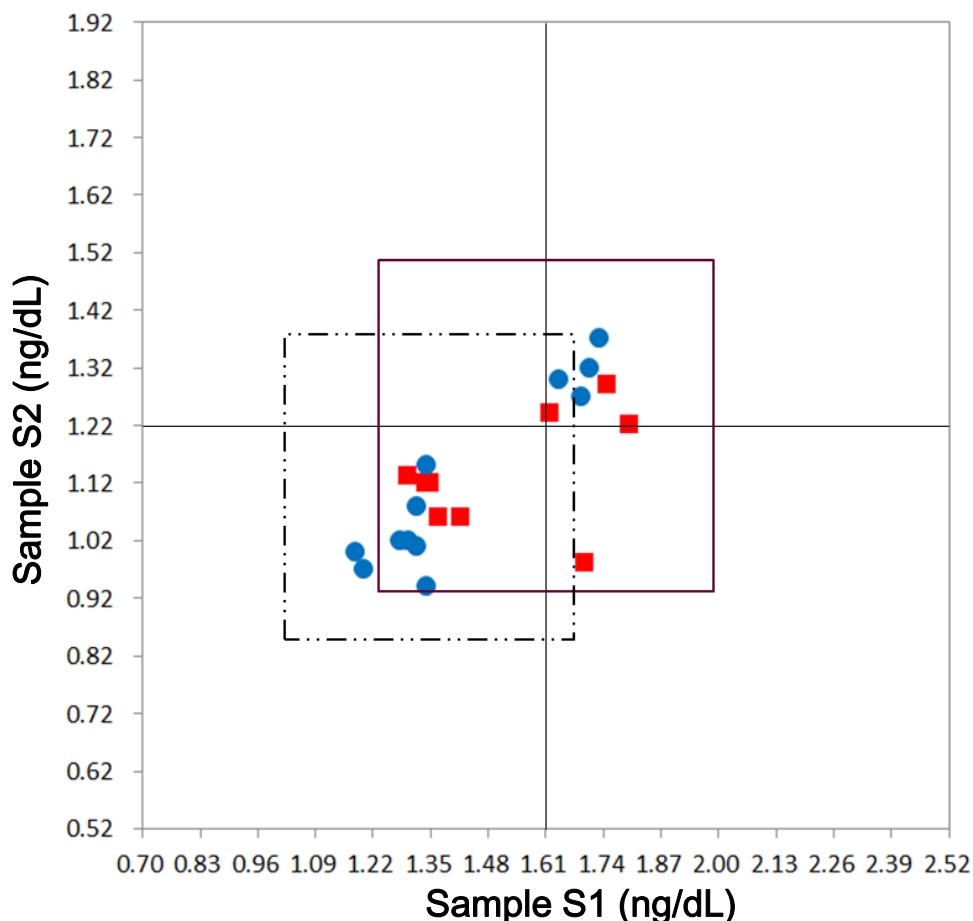

Youden Plot 圖例說明

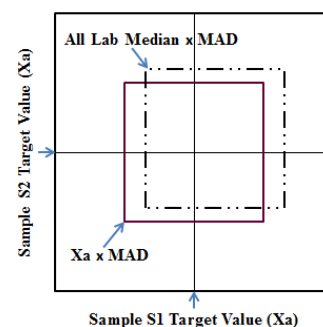

■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation