
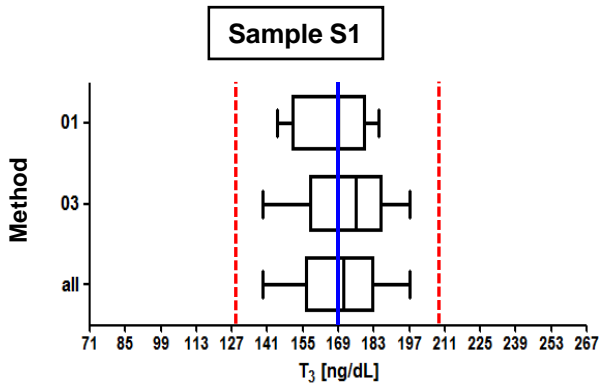


# CHT2016-01 批次 T<sub>3</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2016-01 檢體寄出日期：2016年02月22日 報告截止日期：2016年02月29日


回收份數(比率)：21份(100%)



**檢體 S1**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	169	166*	17.1*	10.3%
04	11	176	174*	16.9*	9.7%
All	21	171	170*	17.5*	10.3%
AEL**	141	189	187	21.8	11.6%

Certified assigned value : 169 ng/dL

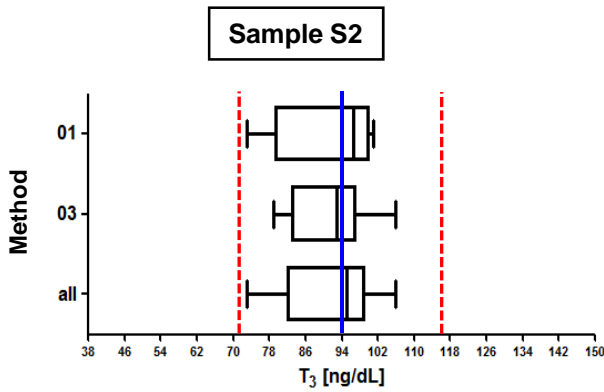

**檢體 S2**


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	10	97	91*	12.0*	13.2%
04	11	93	91*	10.9*	12.0%
All	21	95	91*	11.0*	12.1%
AEL**	137	104	101	13.7	13.6%

Certified assigned value : 94 ng/dL

\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* All European Laboratories

\* — Assigned value , - - - MAD

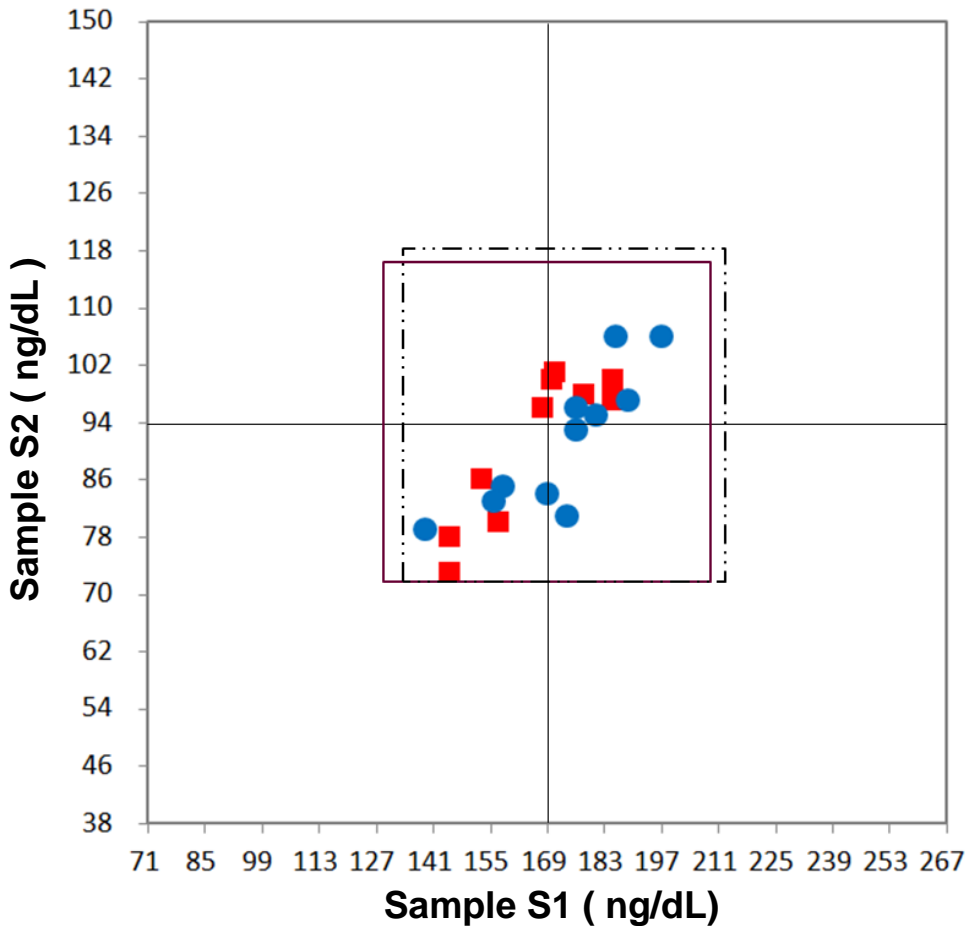

**Youden Plot 圖例說明**

