



CHT2016-01 批次 TSH 檢驗院際品管調查結果統計分佈圖

調查批次：CHT2016-01 檢體寄出日期：2016 年 02 月 22 日 報告截止日期：2016 年 02 月 29 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)




檢體 S1

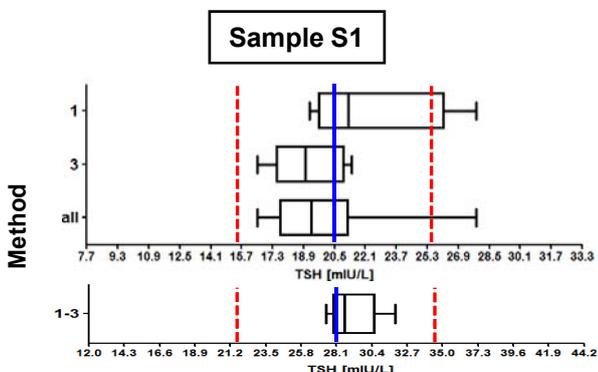

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
1	4	-	-	-	-
03	11	19.0	18.9*	2.00*	10.6%
All	15	19.3	19.5*	2.17*	11.1%
AEL**	1426	20.5	20.2	2.73	13.5%
1-3***	6	28.6	29.1	1.86*	6.4%

檢體 S2

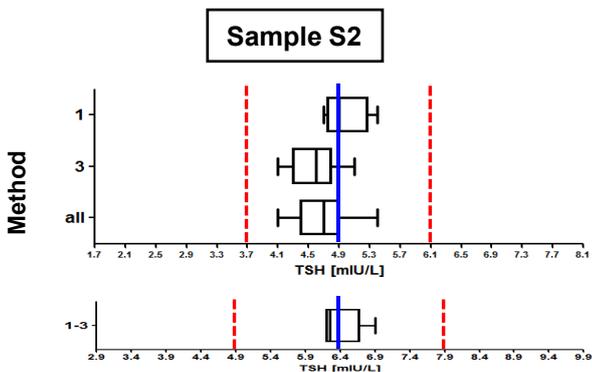


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
1	4	-	-	-	-
3	11	4.6	4.6*	0.36*	7.8%
All	15	4.7	4.7*	0.37*	7.9%
AEL**	1429	4.9	4.9	0.59	12.2%
1-3***	6	6.3	6.4	0.32	5.0%

* — Assigned value, - - - MAD


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

*** 檢體與檢驗試劑不匹配，檢驗值另予統計。

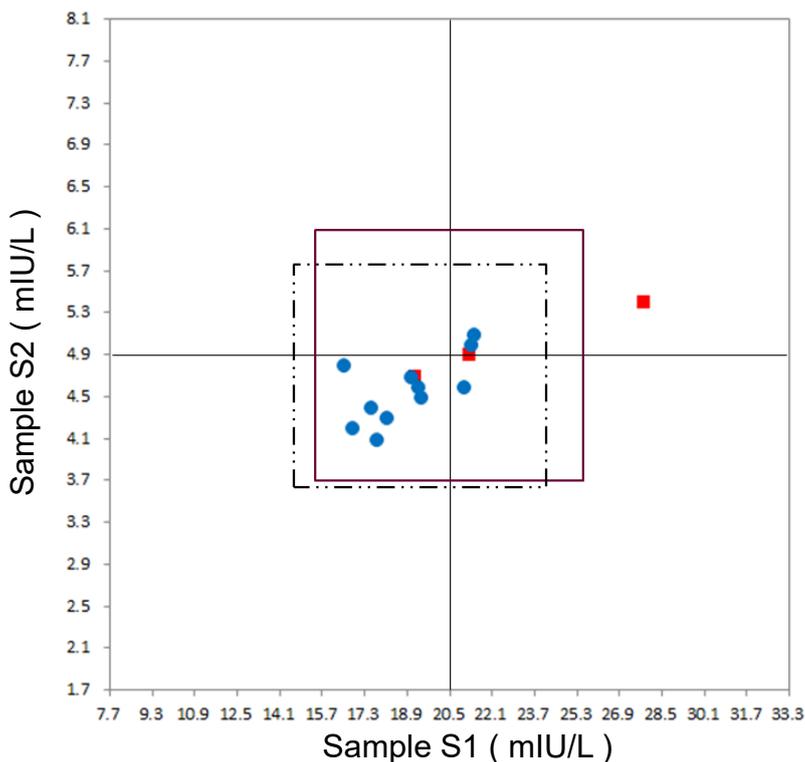

Youden Plot 圖例說明

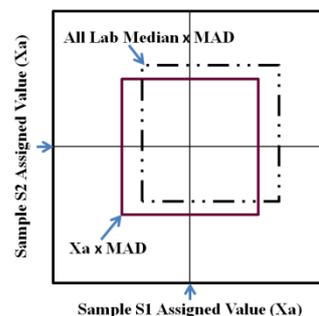


■ Method 1 (RIA)


● Method 3 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation

Method 1-3 Youden Plot

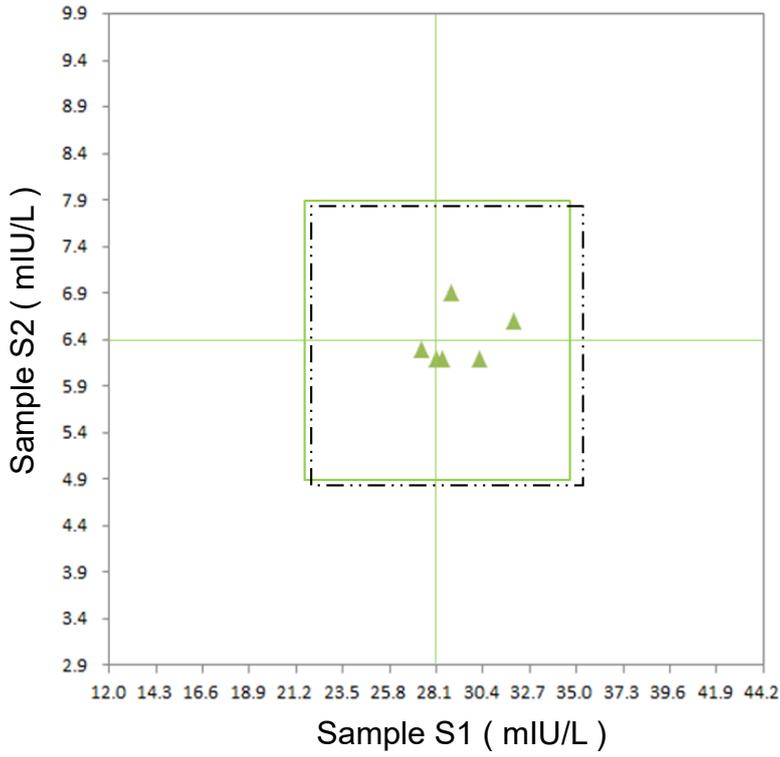

Youden Plot 圖例說明

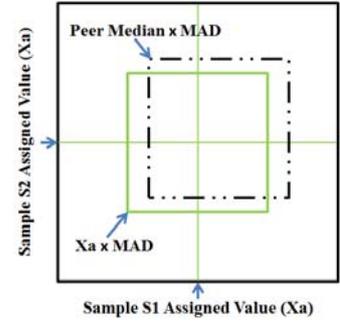

▲ Method 1-3 (RIA-Reagent 3)
 MAD : Maximum Allowable Deviation
 Xa : 品管檢體於歐洲地區大規模院際品管調查結果中位數 (Median) 調整後之數值。