



CHT2016-02 批次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：CHT2016-02 檢體寄出日期：2016年04月18日 報告截止日期：2016年04月25日

回收份數(比率)：21份(100%)




Sample S1

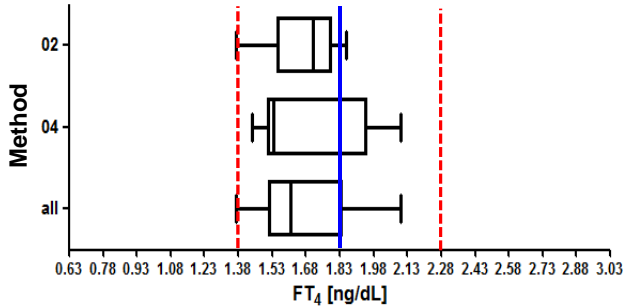

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.71	1.68*	0.16*	9.5%
04	12	1.54	1.67*	0.27*	16.2%
All	21	1.61	1.67*	0.22*	13.2%
AEI**	1216	1.83	1.75	0.23	13.0%

Sample S2

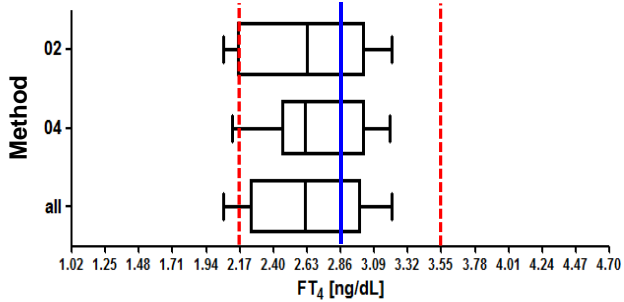


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	2.63	2.59*	0.51*	19.7%
04	12	2.62	2.67*	0.40*	15.0%
All	21	2.62	2.64*	0.44*	16.7%
AEI**	1197	2.86	2.74	0.44	16.0%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

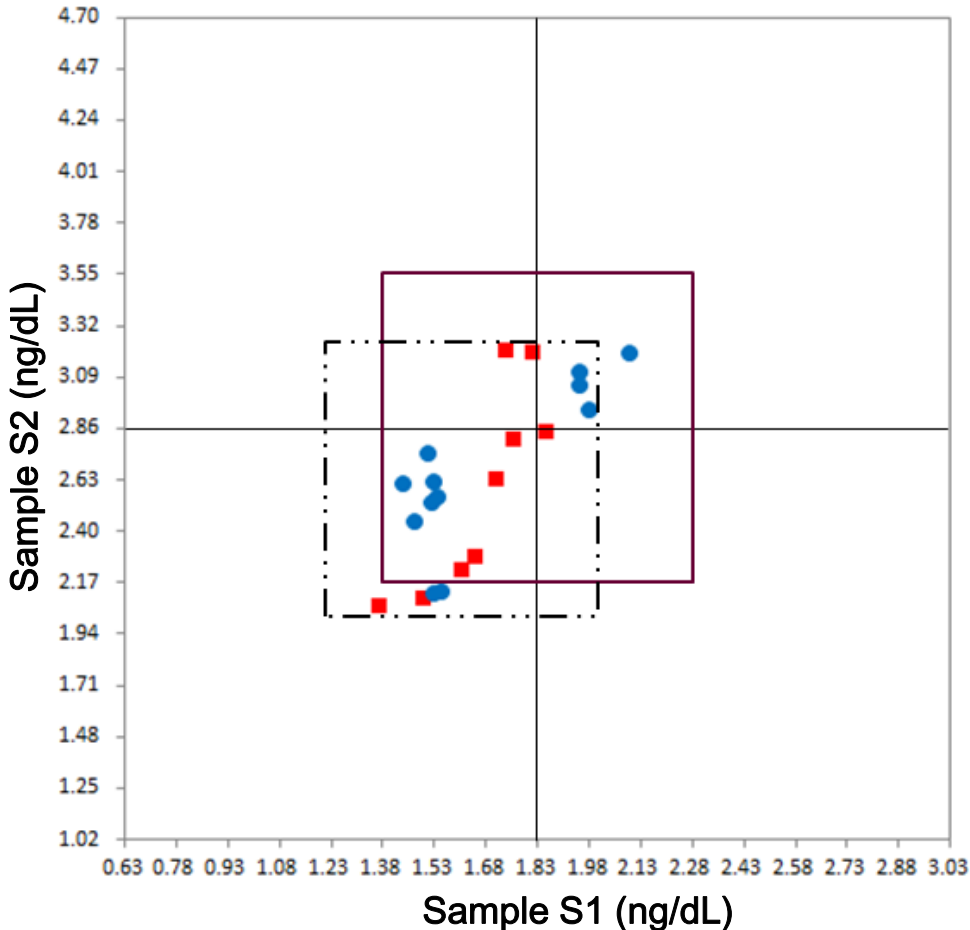

Youden Plot 圖例說明

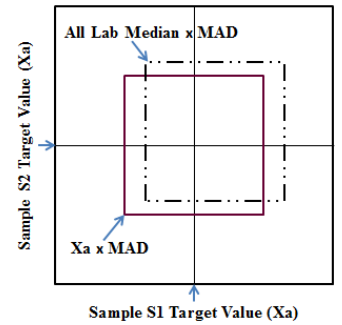

■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation