



CHT2016-03 批次 FT₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號 : CHT2016-03 檢體寄出日期 : 2016 年 07 月 11 日 報告截止日期 : 2016 年 07 月 18 日
 回收份數(比率) : 21 份 (100%)




Sample S1

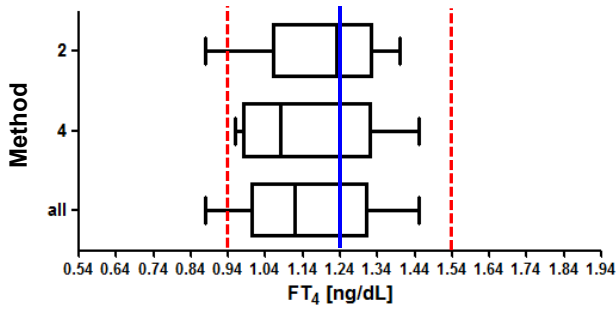

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.23	1.19*	0.18*	15.1%
04	12	1.08	1.14*	0.20*	17.5%
All	21	1.12	1.16*	0.19*	16.4%
AEL**	1197	1.24	1.19	0.16	13.1%

Sample S2

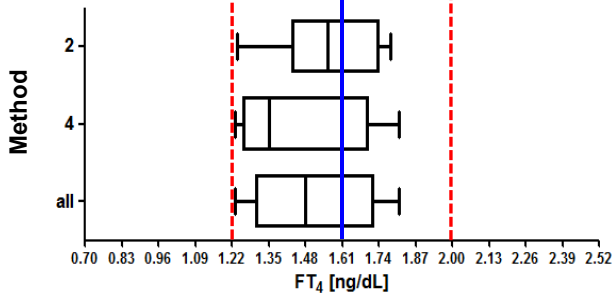


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.56	1.58*	0.20*	12.7%
04	12	1.35	1.45*	0.25*	17.2%
All	21	1.48	1.50*	0.24*	16.0%
AEL**	1196	1.61	1.54	0.21	13.8%


* — Assigned value , - - - MAD

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

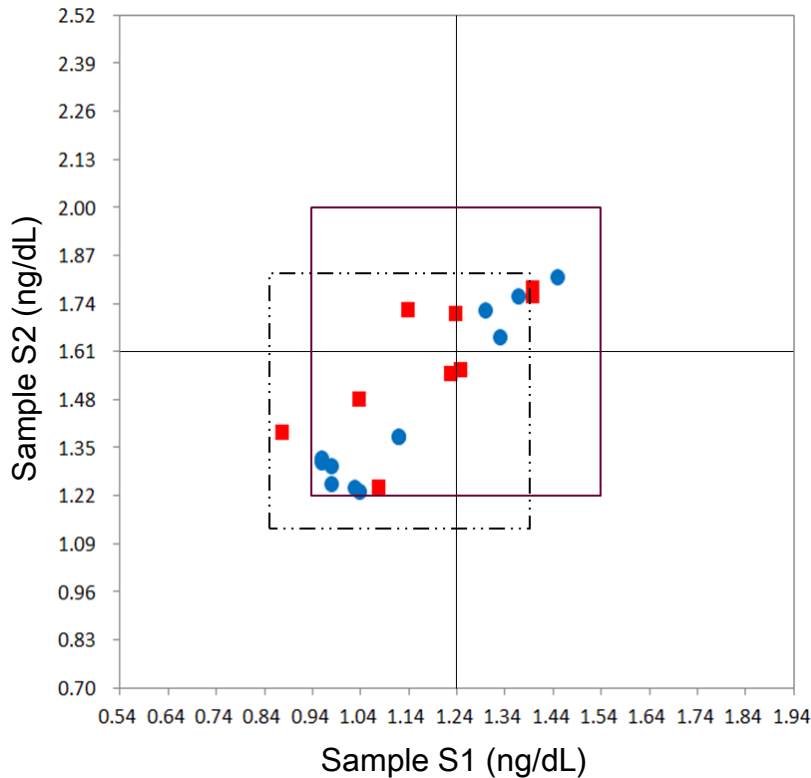

Youden Plot 圖例說明

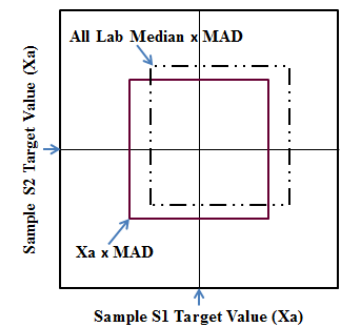

- Method 02 (RIA)
- Method 04 (CLIA)
- MAD : Maximum Allowable Deviation