



# CHT2016-04 批次 FT<sub>4</sub> 檢驗院際品管調查結果統計分佈圖

調查批次：CHT2016-04 檢體寄出日期：2016 年 10 月 24 日 報告截止日期：2016 年 10 月 31 日  
 回收份數(比率)：21 份 (100%)




Sample S1

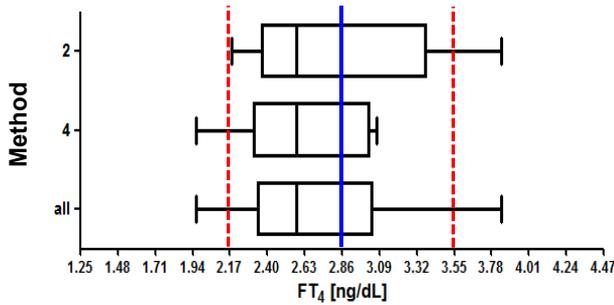

檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	2.58	2.81*	0.65*	23.1%
04	12	2.58	2.59*	0.44*	17.0%
All	21	2.58	2.66*	0.47*	17.7%
AEL**	1197	2.86	2.74	0.44	16.0%

Sample S2

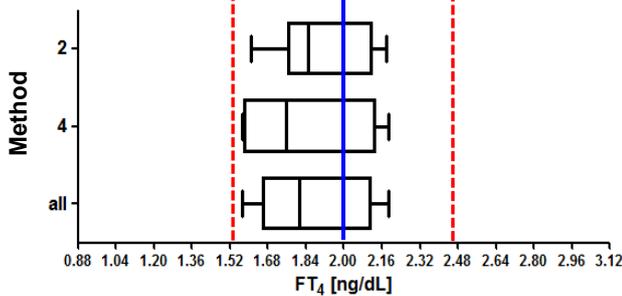


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	9	1.85	1.90*	0.23*	12.1%
04	12	1.76	1.82*	0.28*	15.4%
All	21	1.81	1.86*	0.26*	14.0%
AEL**	1180	2.00	1.92	0.25	12.9%


\* — Assigned value, - - - MAD

\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* All European Laboratories

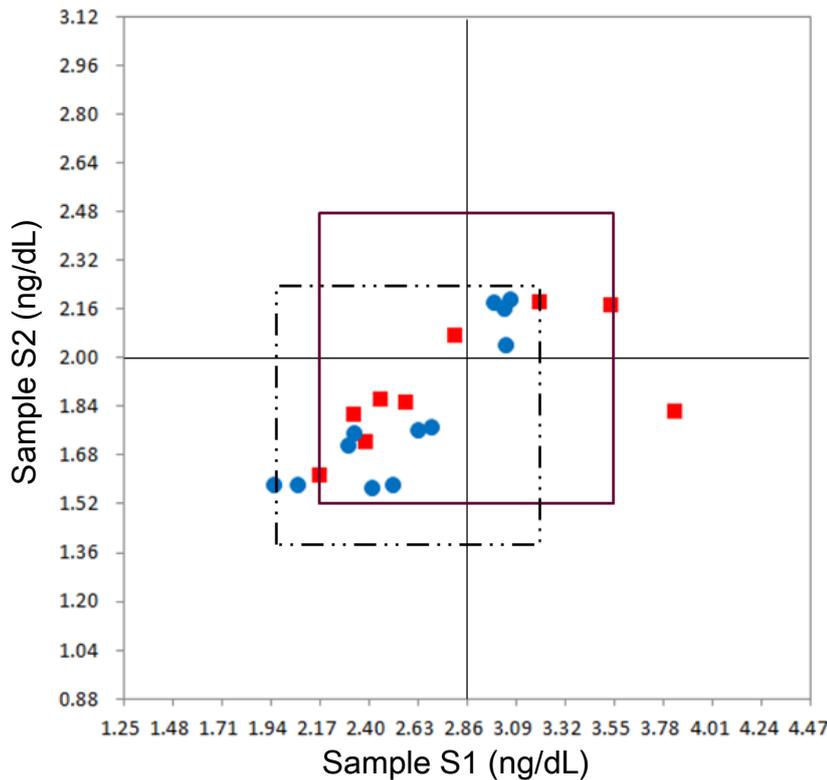

Youden Plot 圖例說明

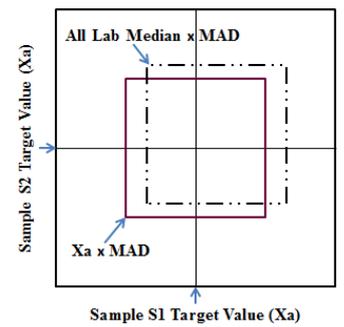

■ Method 02 ( RIA )  
 ● Method 04 ( CLIA )  
 MAD : Maximum Allowable Deviation