
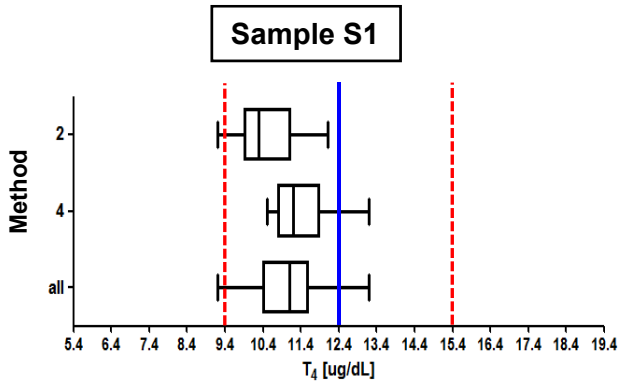



CHT2016-04 批次 T₄ 檢驗院際品管調查結果統計分佈圖

調查批次：CHT2016-04 檢體寄出日期：2016 年 10 月 24 日 報告截止日期：2016 年 10 月 31 日
 回收份數(比率)：21 份 (100%)



檢體 S1


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	10.3	10.4*	0.94*	9.0%
04	13	11.2	11.4*	0.77*	6.8%
All	21	11.1	11.0*	0.92*	8.4%
AEL**	117	12.0	12.2	1.49	12.2%

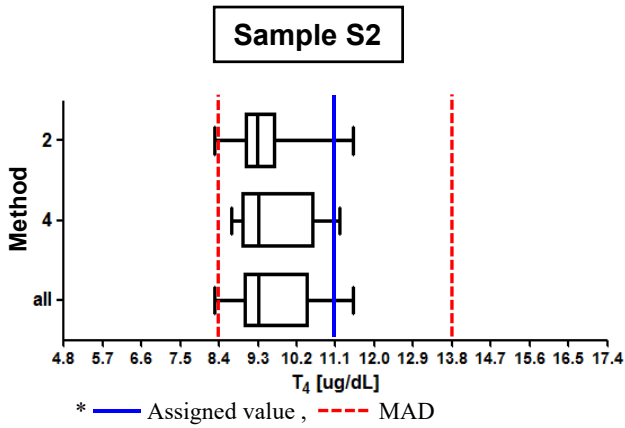

檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	9.3	9.3*	0.60*	6.5%
04	13	9.3	9.7*	0.99*	10.2%
All	21	9.3	9.6*	0.92*	9.6%
AEL**	104	10.5	10.6	1.06	9.9%

Certified assigned value : 11.1 μg/dL
 * Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** All European Laboratories

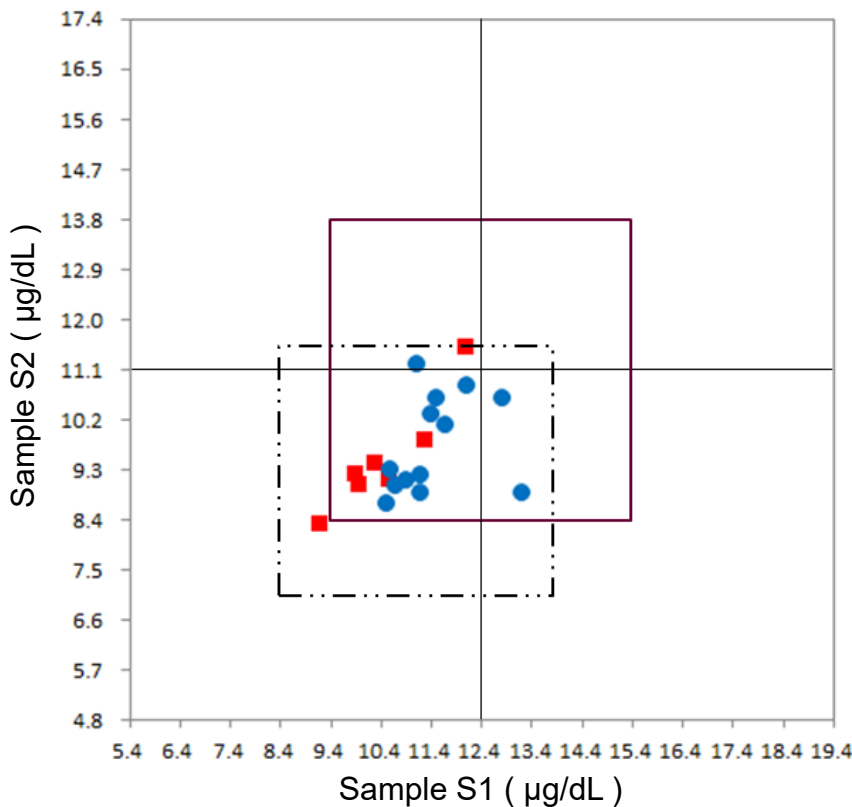

Youden Plot 圖例說明

