
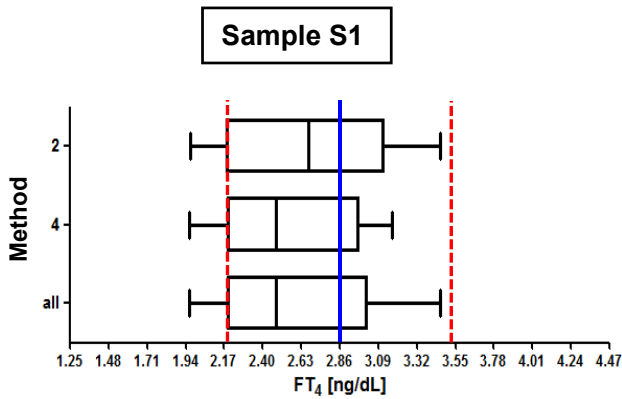



# CHT2017-01 批次 FT<sub>4</sub> 檢驗院際品管調查結果統計分佈圖

調查批次：CHT2017-01 檢體寄出日期：2017 年 02 月 06 日 報告截止日期：2017 年 02 月 13 日  
 回收份數(比率)：21 份 (100%)



**檢體 S1**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	2.67	2.68*	0.600*	22.4%
04	13	2.48	2.54*	0.456*	18.0%
All	21	2.48	2.59*	0.492*	19.0%
AEL**	1197	2.86	2.74	0.436	16.0%

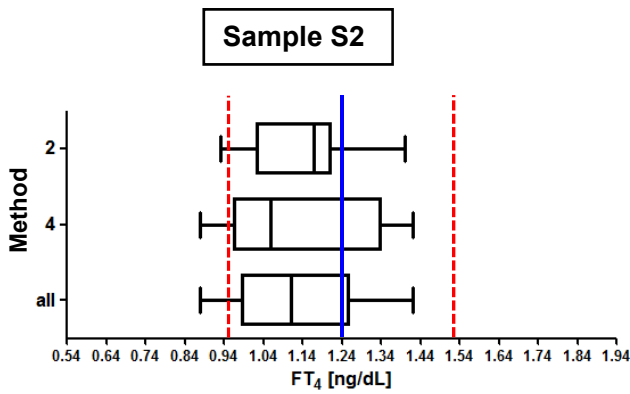


**檢體 S2**

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	1.17	1.15*	0.159*	13.8%
04	13	1.06	1.12*	0.214*	19.1%
All	21	1.11	1.13*	0.192*	17.0%
AEL**	1197	1.24	1.19	0.155	13.1%


\* Calculated by robust method ( ISO 13528 ; Algorithm A )

\*\* All European Laboratories

\* — Assigned value , - - - MAD

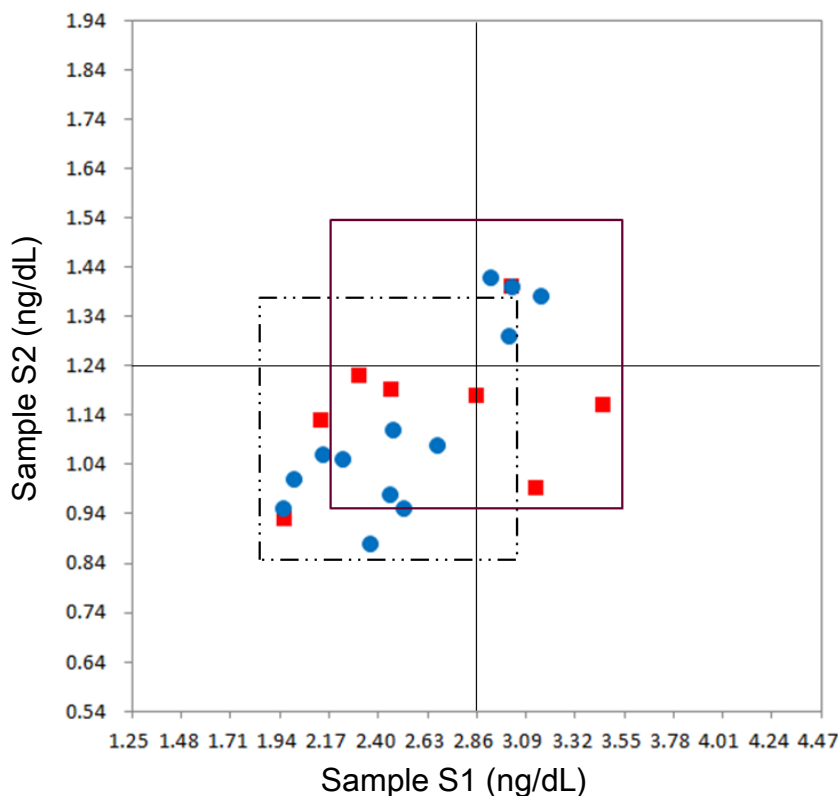

**Youden Plot 圖例說明**

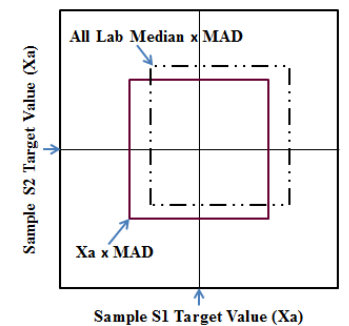

- Method 02 ( RIA )
- Method 04 ( CLIA )
- MAD : Maximum Allowable Deviation