



CHT2017-02 批次 T₄ 檢驗院際品管調查結果統計分佈圖

調查批次：CHT2017-02 檢體寄出日期：2017 年 04 月 10 日 報告截止日期：2017 年 04 月 17 日
 回收份數(比率)：22 份 (100%)



Sample S1

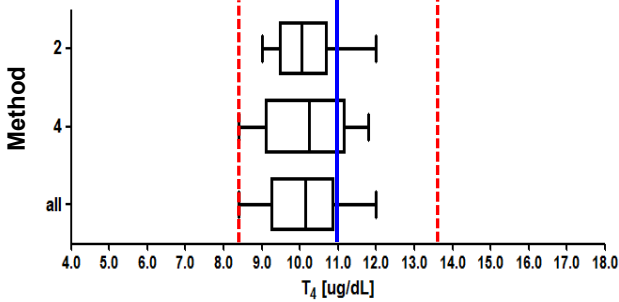


檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	10.1	10.1*	0.89*	8.8%
04	14	10.3	10.2*	1.20*	11.8%
All	22	10.2	10.2*	1.09*	10.7%
AEL**	108	10.8	10.7	1.52	14.2%

Certified assigned value : 11.0 µg/dL

Sample S2

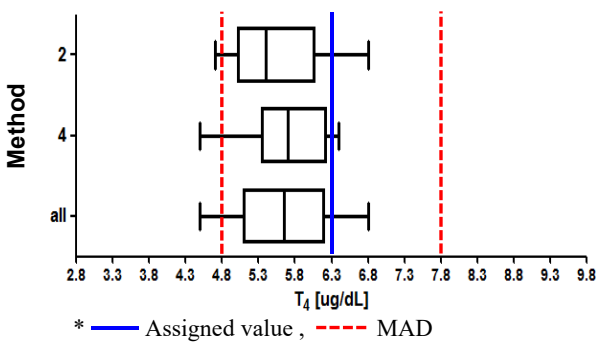


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	5.4	5.6*	0.78*	13.9%
04	14	5.7	5.8*	0.57*	9.8%
All	22	5.7	5.7*	0.66*	11.6%
AEL**	117	6.2	6.3	0.82	13.0%


Certified assigned value : 6.3 µg/dL

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

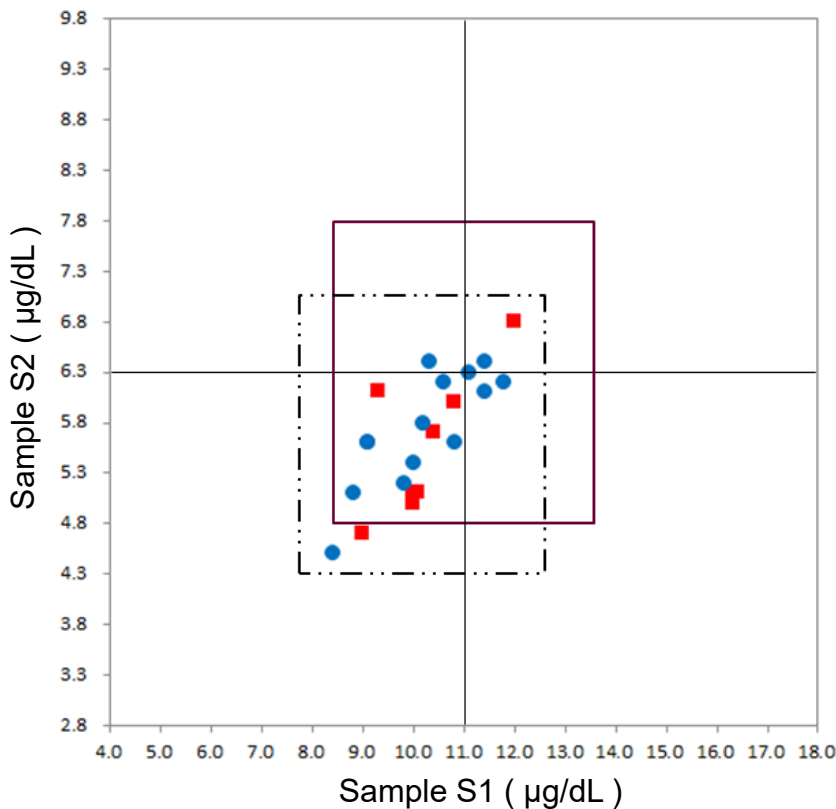

Youden Plot 圖例說明

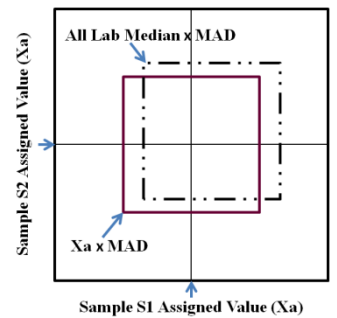

■ Method 02 (RIA)

● Method 04 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation