


CHT2017-03 批次 FT₄ 檢驗院際品管調查結果統計分布圖


調查批次：CHT2017-03 檢體寄出日期：2017年06月26日 報告截止日期：2017年07月03日

回收份數(比率)：22份(100%)

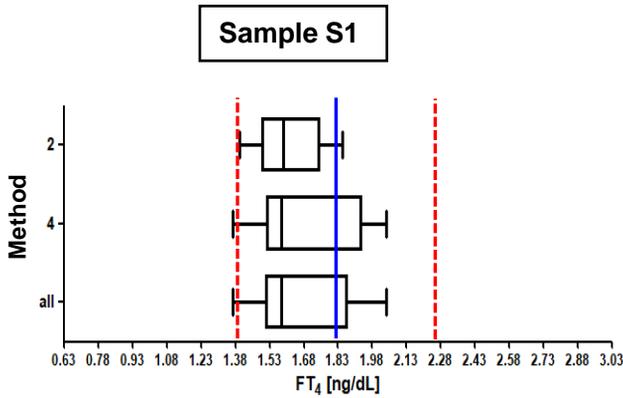


Sample S1

檢體 S1



Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
2	8	1.59	1.61	0.172*	10.7%
4	14	1.58	1.69*	0.260*	15.4%
All	22	1.58	1.66*	0.226*	13.6%
AEL**	1216	1.83	1.75	0.230	13.0%

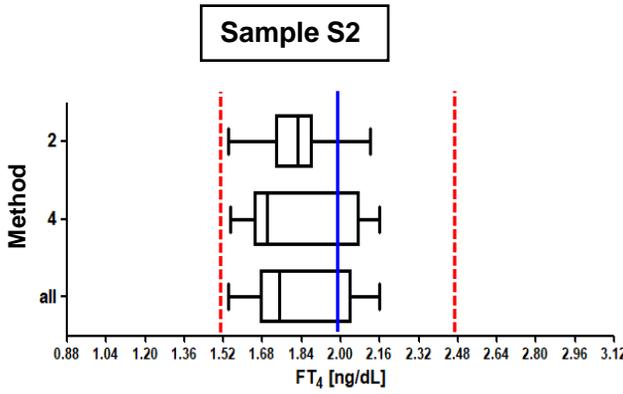

Sample S2


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
2	8	1.83	1.82*	0.132*	7.3%
4	14	1.70	1.82*	0.250*	13.7%
All	22	1.75	1.82*	0.224*	12.3%
AEL**	1257	2.00	1.91	0.272	14.3%


* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

* — Assigned value, - - - MAD

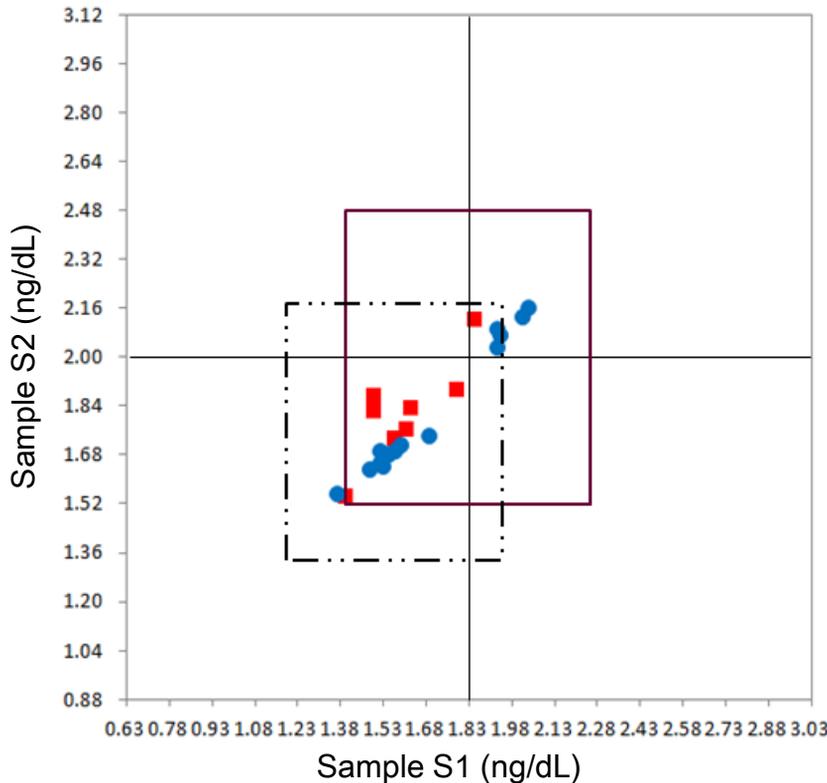

Youden Plot 圖例說明

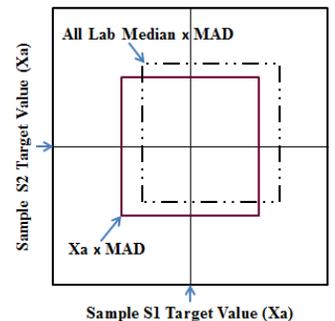

- Method 2 (RIA)
- Method 4 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation