
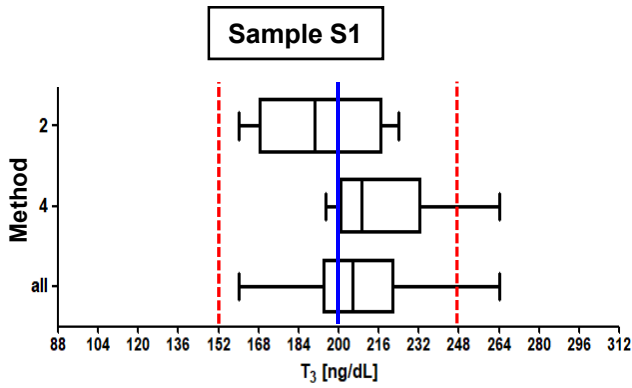


CHT2018-01 批次 T₃ 檢驗院際品管統計分布圖


調查批次：CHT2018-01 檢體寄出日期：2018 年 06 月 04 日 報告截止日期：2018 年 06 月 11 日
 回收份數(比率)：22 份 (100%)



檢體 S1

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
2	8	191	192*	27.2*	14.2%
4	14	209	216*	22.6*	10.5%
All	22	206	207*	24.7*	11.9%
AEL**	152	228	226	22.5	10.0%

Certified assigned value : 200 ng/dL

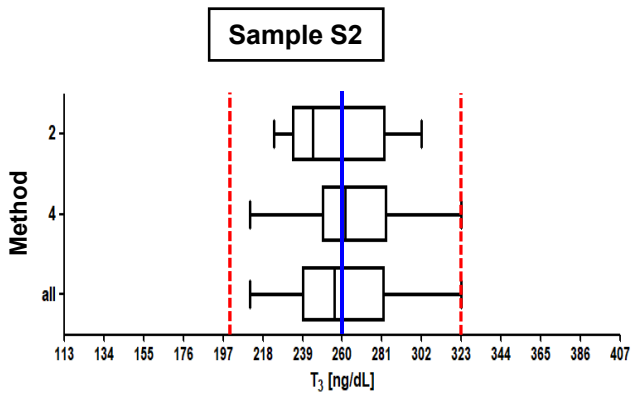


檢體 S2

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
2	8	245	254*	32.1*	12.6%
4	14	262	264*	30.9*	11.7%
All	22	256	260*	30.7*	11.8%
AEL**	149	289	289	37.8	13.1%


Certified assigned value : 260 ng/dL

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)
 ** All European Laboratories

* — Assigned value , - - - MAD

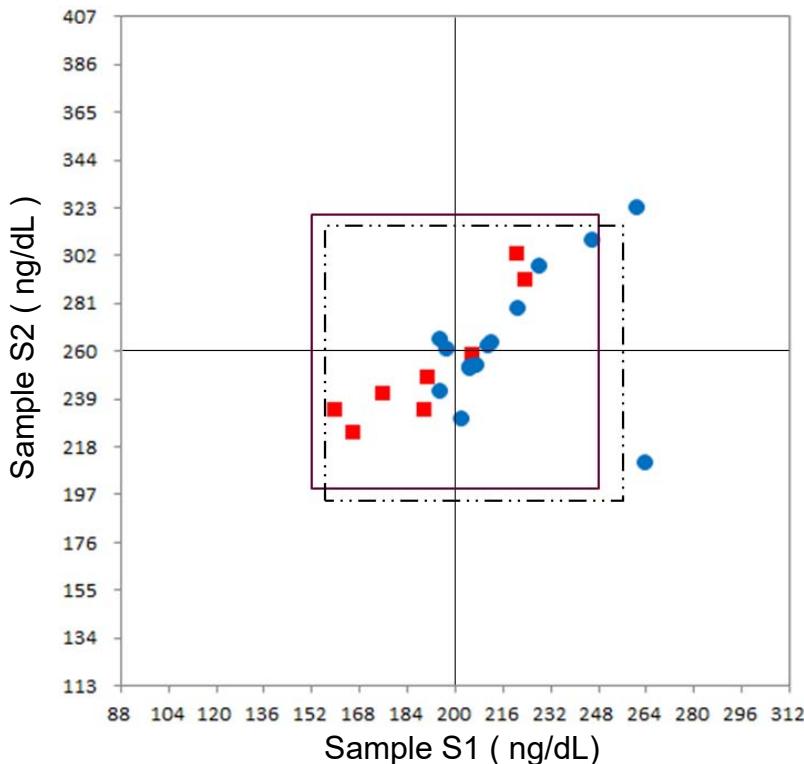

Youden Plot 圖例說明

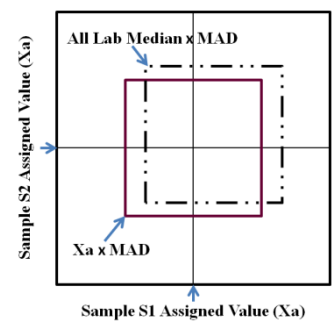

■ Method 2 (RIA)
 ● Method 4 (CLIA)
 MAD : Maximum Allowable Deviation