
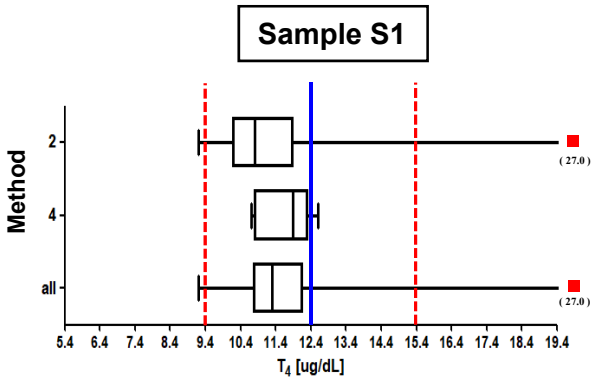


CHT2018-01 批次 T₄ 檢驗院際品管調查結果統計分布圖


調查批次：CHT2018-01 檢體寄出日期：2018 年 06 月 04 日 報告截止日期：2018 年 06 月 11 日
 回收份數(比率)：22 份 (100%)



檢體 S1

| Method | 檢驗單位數 | 中位值 (Median) | 平均值 (Mean) | 標準差 (SD) | 變異係數 (CV) |
|--------|-------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2 | 7 | 10.8 | 10.9* | 1.39* | 12.8% |
| 4 | 15 | 11.9 | 11.6* | 0.80* | 6.9% |
| All | 22 | 11.3 | 11.4* | 0.95* | 8.3% |
| AEL** | 117 | 12.0 | 12.2 | 1.49 | 12.2% |

Certified assigned value : 12.4 µg/dL

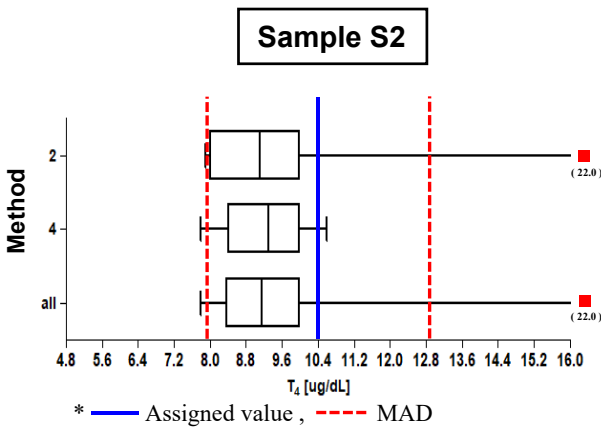


檢體 S2

| Method | 檢驗單位數 | 中位值 (Median) | 平均值 (Mean) | 標準差 (SD) | 變異係數 (CV) |
|--------|-------|--------------|------------|----------|-----------|
| 2 | 7 | 9.1 | 9.1* | 1.26* | 13.8% |
| 4 | 15 | 9.3 | 9.3* | 0.99* | 10.6% |
| All | 22 | 9.2 | 9.2* | 1.04* | 11.3% |
| AEL** | 118 | 9.9 | 9.9 | 0.99 | 10.0% |


Certified assigned value : 10.4 µg/dL

* Calculated by robust method (ISO 13528 ; Algorithm A)

** All European Laboratories

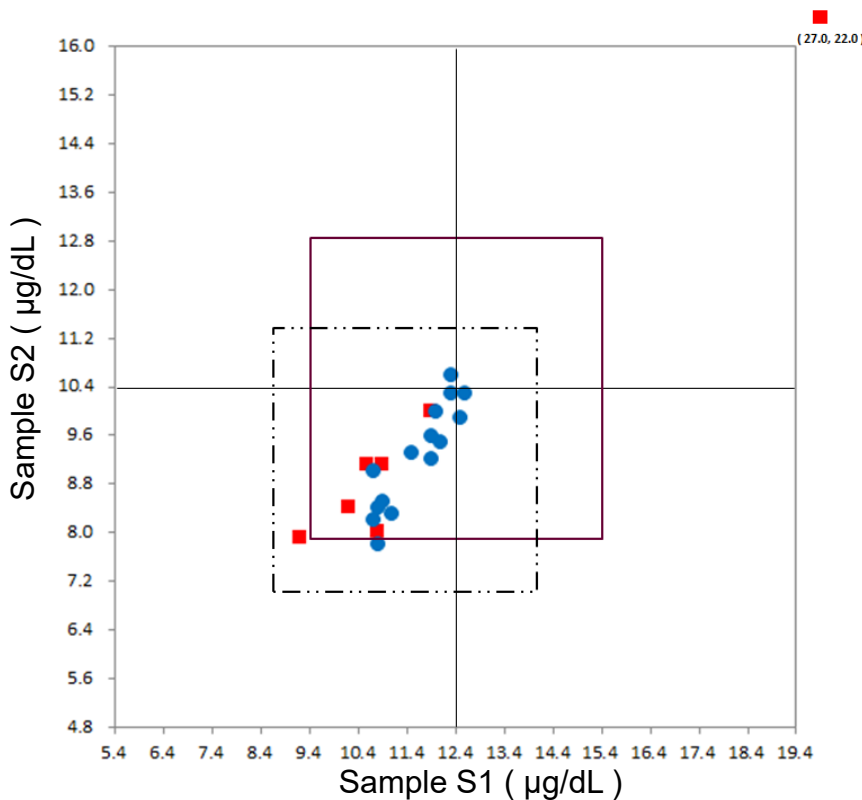

Youden Plot 圖例說明

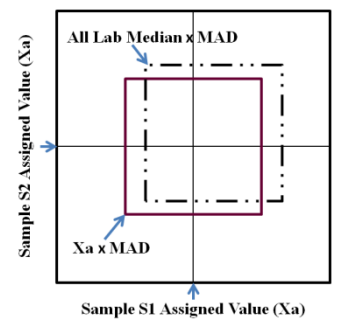

■ Method 2 (RIA)

● Method 4 (CLIA)

MAD : Maximum Allowable Deviation