


# AQ2013-06 批次 FT<sub>4</sub> 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：AQ2013-06

檢體寄出日期：102 年 06 月 03 日


報告截止日期：102 年 06 月 10 日

回收份數(比率)：20 份 (100%)



Sample S1


檢體 S1

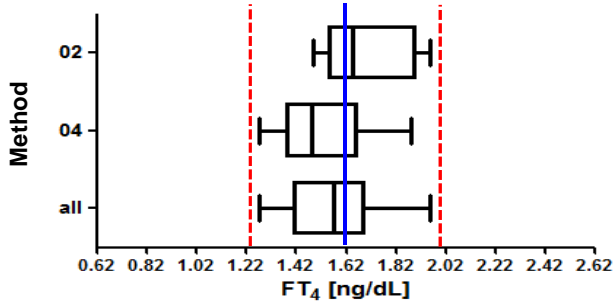

Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	1.65	1.70	0.20	11.8%
04	12	1.49	1.51	0.19	12.6%
All	20	1.57	1.59	0.21	13.2%
AEL*	1177	1.62	1.60	0.20	12.7%

Sample S2


檢體 S2

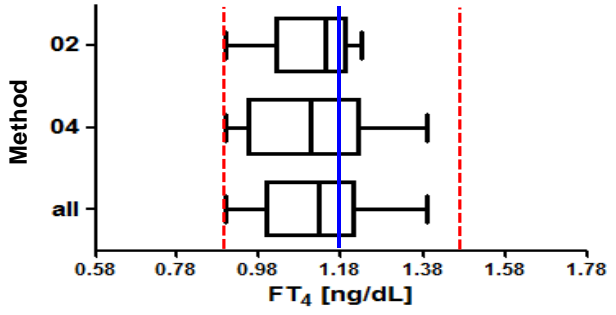


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	1.14	1.12	0.11	9.8%
04	12	1.11	1.12	0.18	16.1%
All	20	1.13	1.11	0.15	13.5%
AEL*	1140	1.18	1.16	0.15	13.0%

\* All European Laboratories

\* — Target, - - - MAD

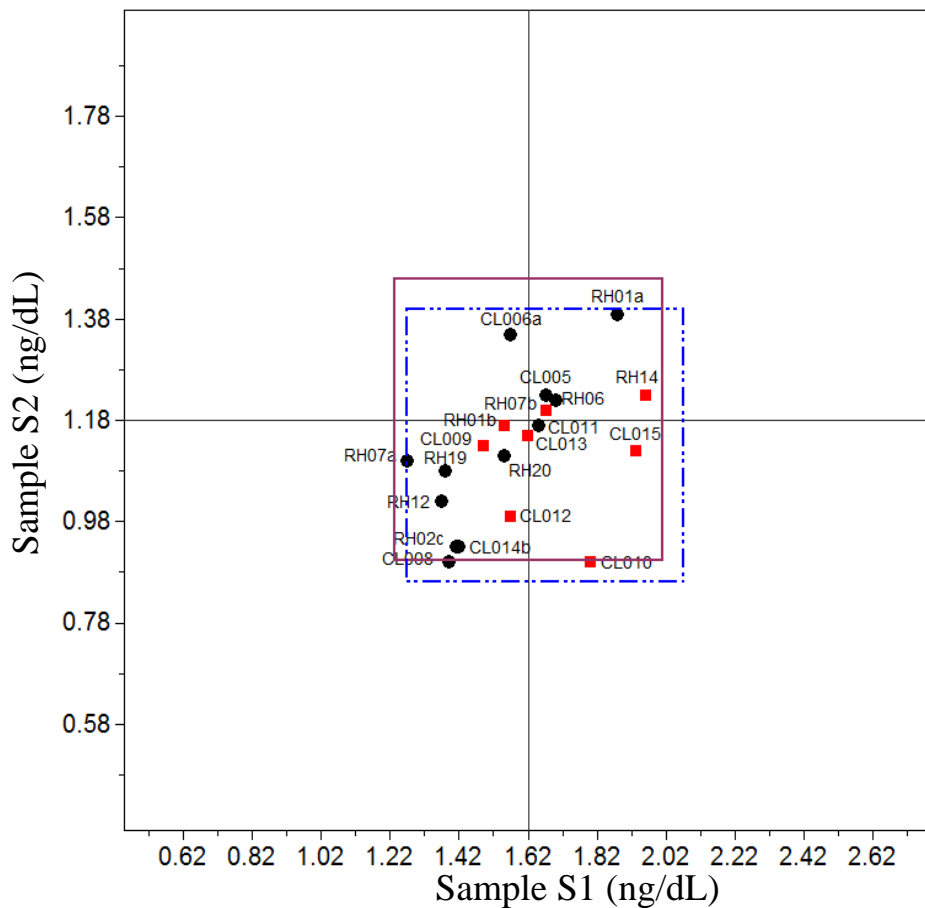

Youden Plot 圖例說明

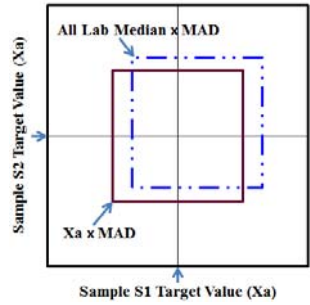

- Method 02 ( RIA )
  - Method 04 ( CLIA )
- Maximum allowable deviation (MAD) = 24%