


AQ2013-06 批次 T₄ 檢驗院際品管統計分佈圖

送檢批號：AQ2013-06

檢體寄出日期：102 年 06 月 03 日


報告截止日期：102 年 06 月 10 日

回收份數(比率)：21 份 (100%)



Sample S1

檢體 S1

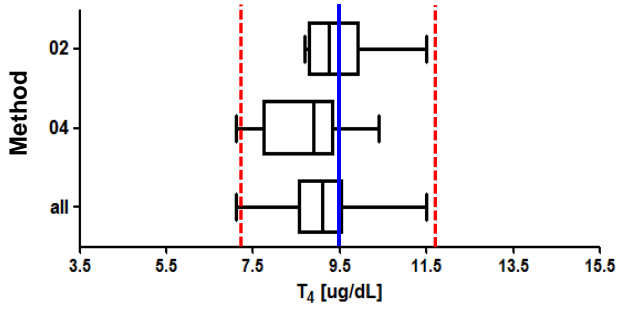


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	9.3	9.4	0.72	7.7%
04	13	8.9	8.7	1.13	13.0%
All	21	9.1	9.0	0.92	10.2%
AEL**	125	9.2	9.2	1.02	11.2%

Certified Target Value : 9.5 µg/dL

Sample S2

檢體 S2

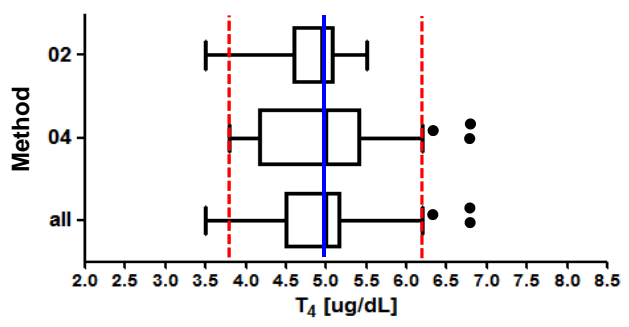


Method	檢驗單位數	中位值 (Median)	平均值 (Mean)	標準差 (SD)	變異係數 (CV)
02	8	5.0	4.9	0.46	9.4%
04*	10	5.0	4.9	0.80	16.3%
All*	18	5.0	4.9	0.62	12.7%
Kit 2	3	6.8	6.6	0.29	4.4%
AEL**	116	5.4	5.4	0.77	15.4%


Certified Target Value : 5.0 µg/dL

* not including kit 2 (see summary table note 5)
 ** All European Laboratories

* — Target, - - - MAD

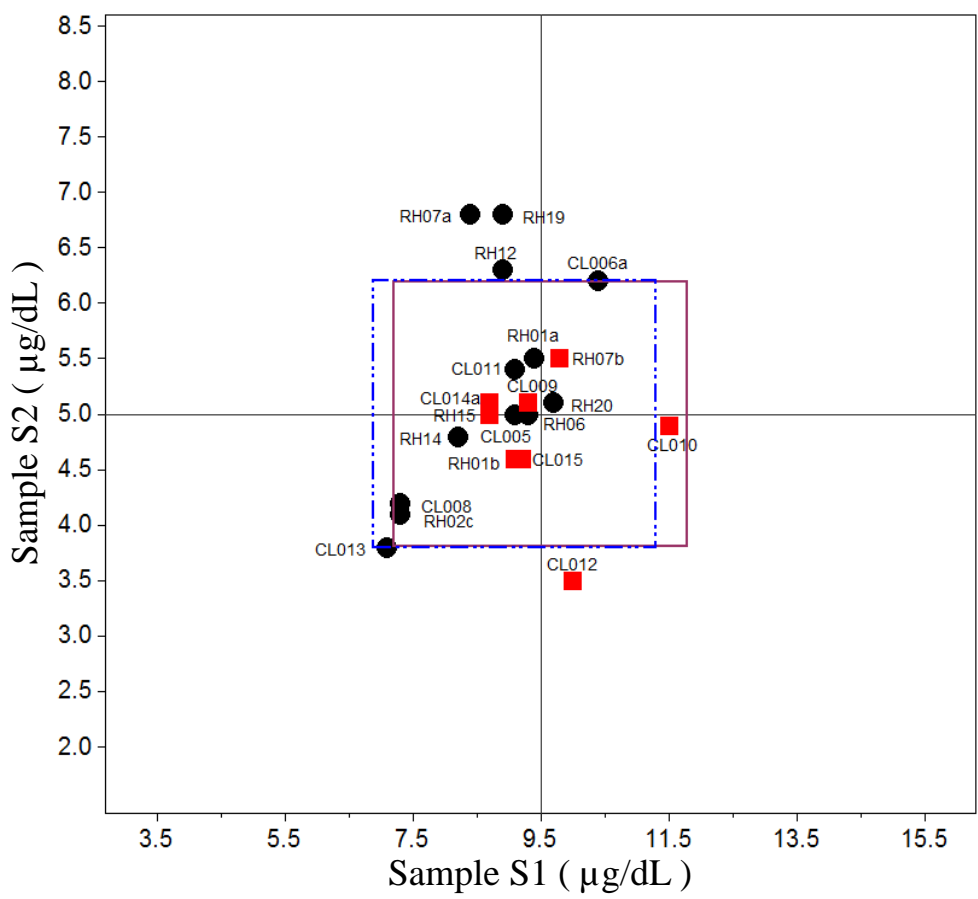

Youden Plot 圖例說明

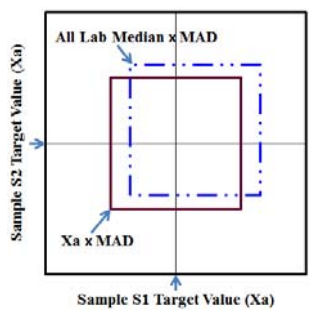

■ Method 02 (RIA)
 ● Method 04 (CLIA)
 Maximum allowable deviation (MAD) = 24%